

ESKİ CABG'LI HASTADA LAD KRONİK TOTAL OKLÜZYONA BAŞARILI PERKUTAN KORONER GİRİŞİM

Uzm. Dr. Halil ATAŞ

Doç. Dr. Kürşat TİGEN

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu

- 64 y kadın hasta
- Göğüs ağrısı (CCS III, 3 aydır)
- 1 yıl önce 3 damar CABG yapılmış.
- Hipertansiyon ve hiperlipidemi mevcut.


- Kullandığı ilaçlar: ASA 100mg metoprolol 50 mg atorvastatin 40 mg valsartan 160mg+hidroklorotiazid 12,5 mg
- FM: Özellik yok
- EKG: NSR , sol aks HR 86
- TTE: Normal sol ventrikül sistolik fonksiyonları sol ventrikül diastolik disfonksiyonu ve sol ventrikül hipertrofisi.


Myokard perfüzyon sintigrafisi(SPECT) yapıldı:


- Apeks , apikal inferior, apikal inferolateral, apikal mid anterior, segmentler ile septumda (anteroseptal duvarda belirginleşen farmakolojik stres ile uyarılan iskemi bulgusu saptandı).
- Apeks ve septumda post stress hipokinezi saptandı.

Diagnostik KAG

- LAD proksimalden total tıkalı
- CX kritik darlık izlenmedi
- RCA ince yapıda
(Proksimal %95 darlık, mid bölgede %90 darlık)

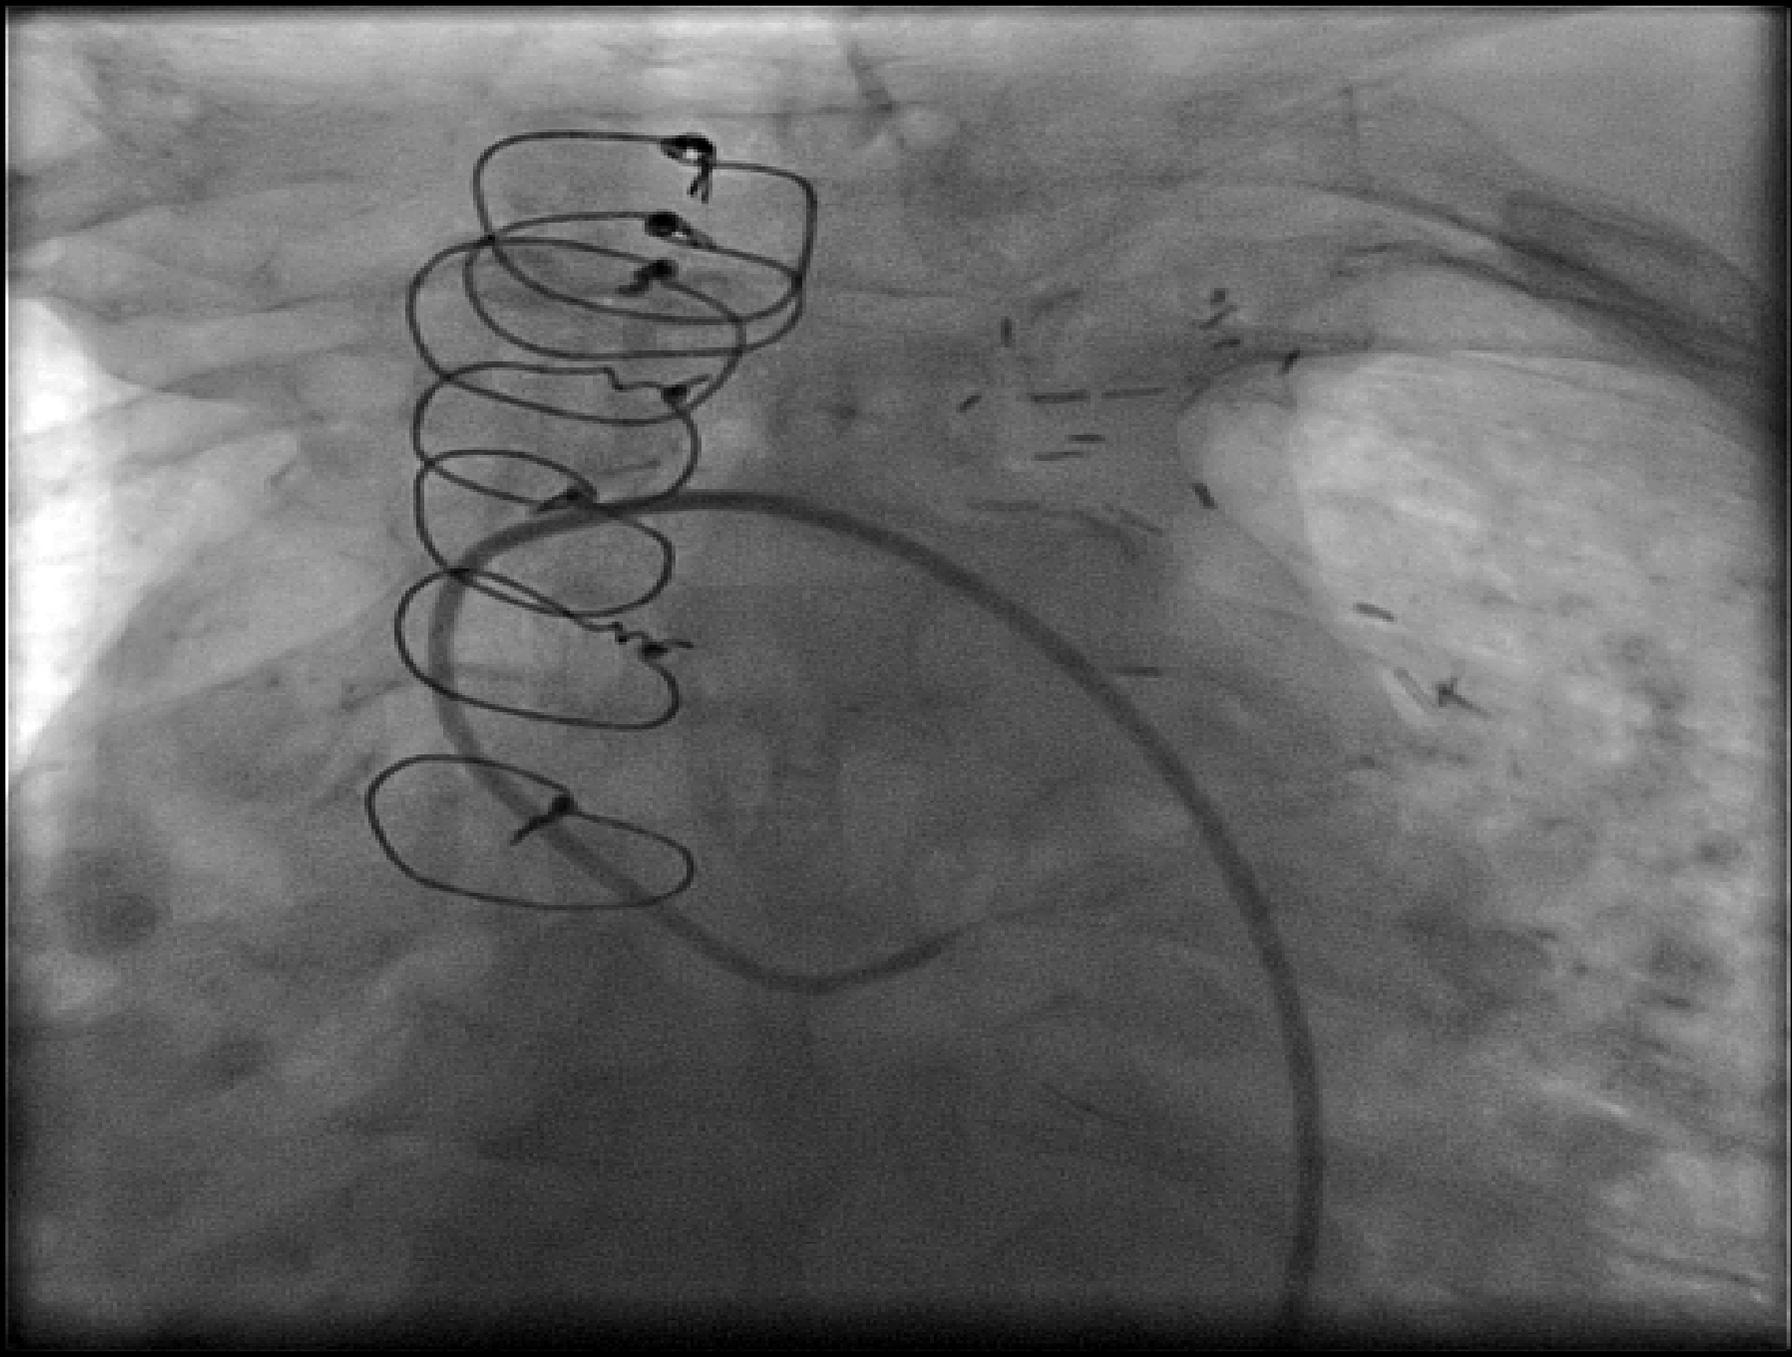

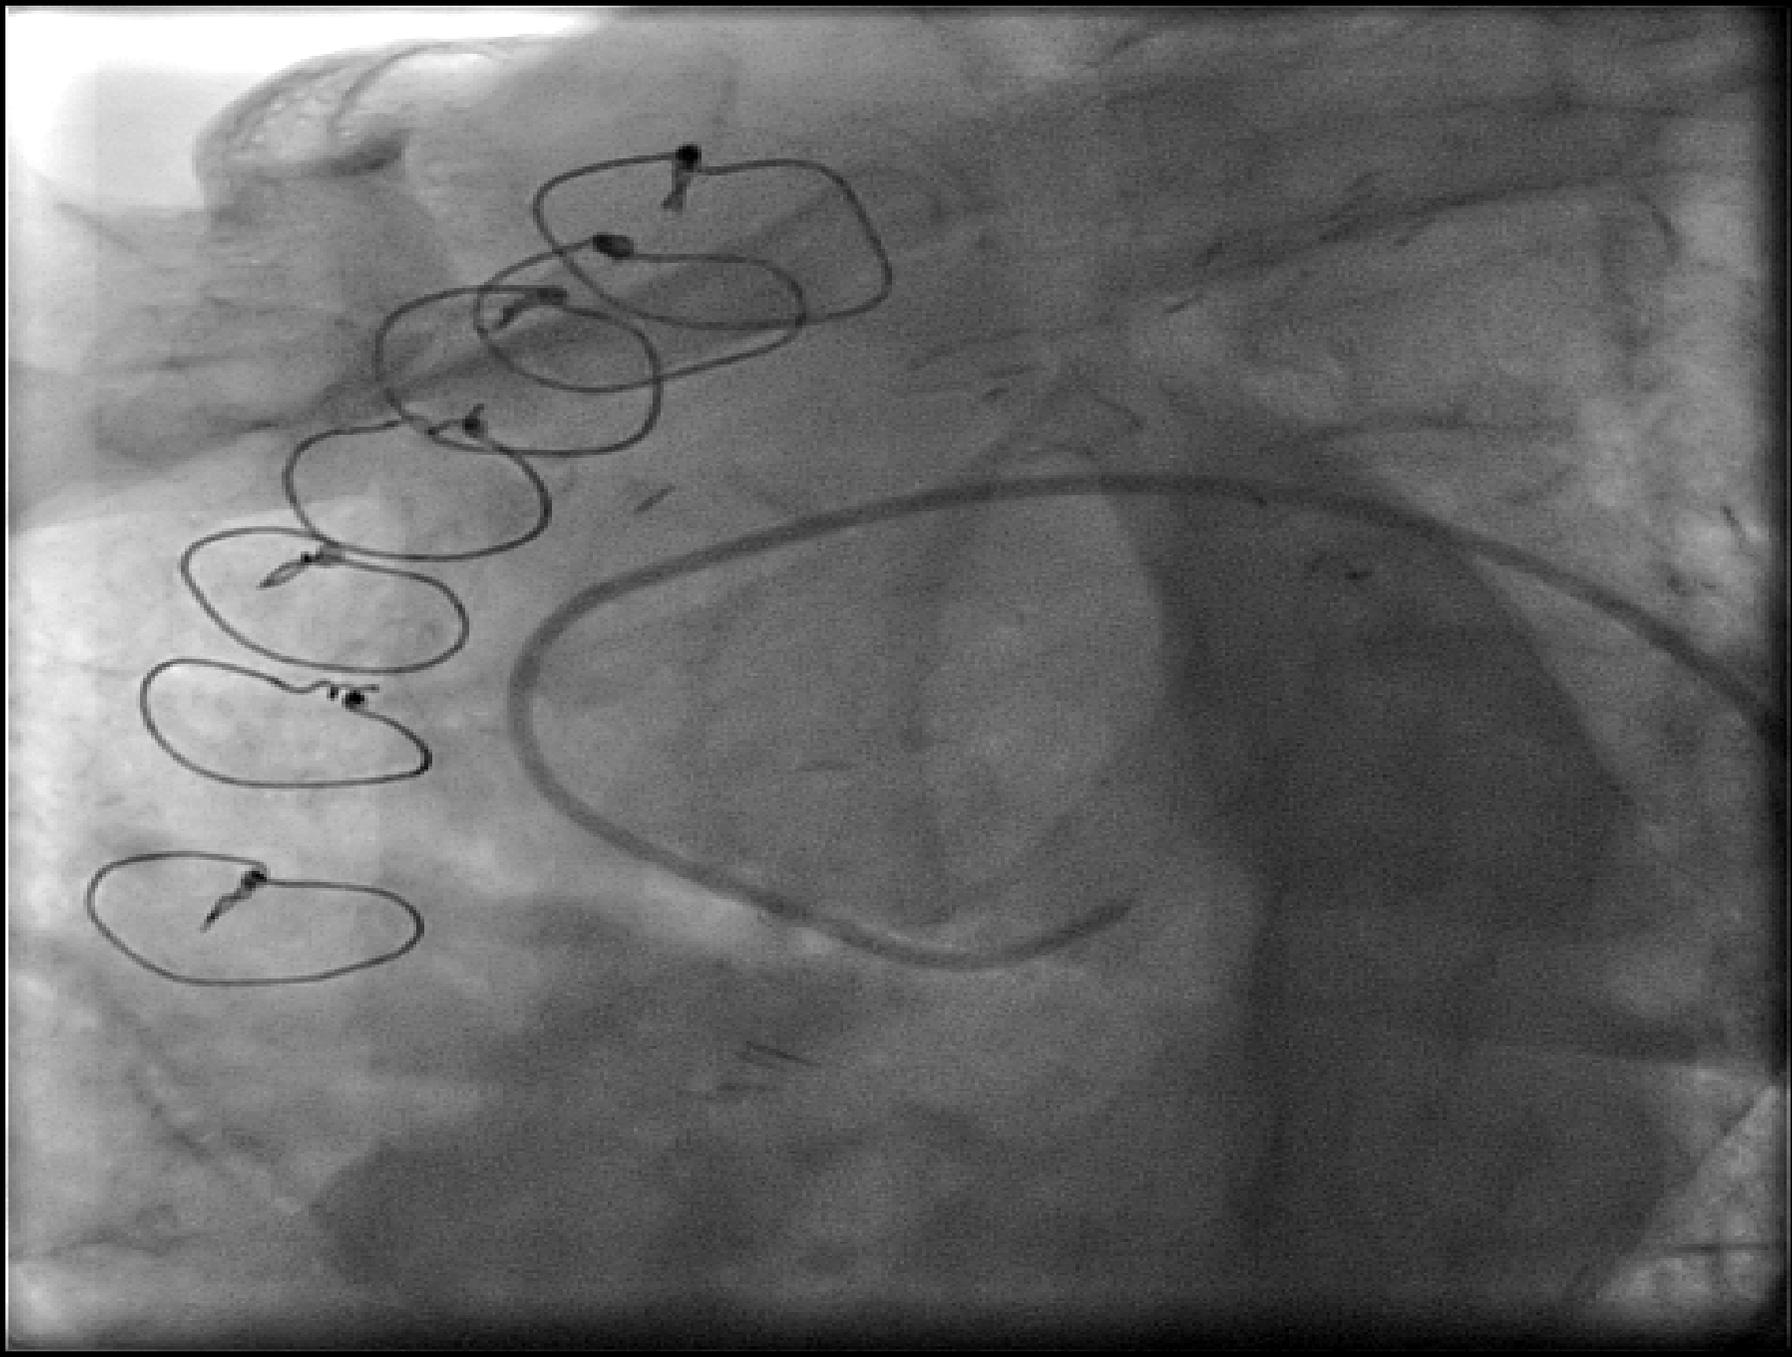


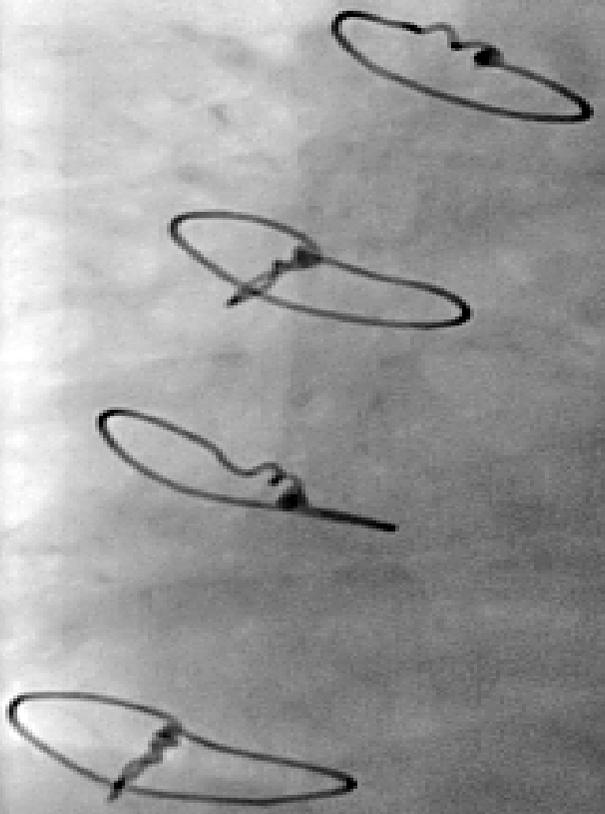


Diagnostik KAG

- Ao-Safen-RCA grefti patent
- Ao-Safen-D₁ grefti patent
- LIMA-LAD grefti ince yapıda distal perfüzyonu yetersiz izlendi.



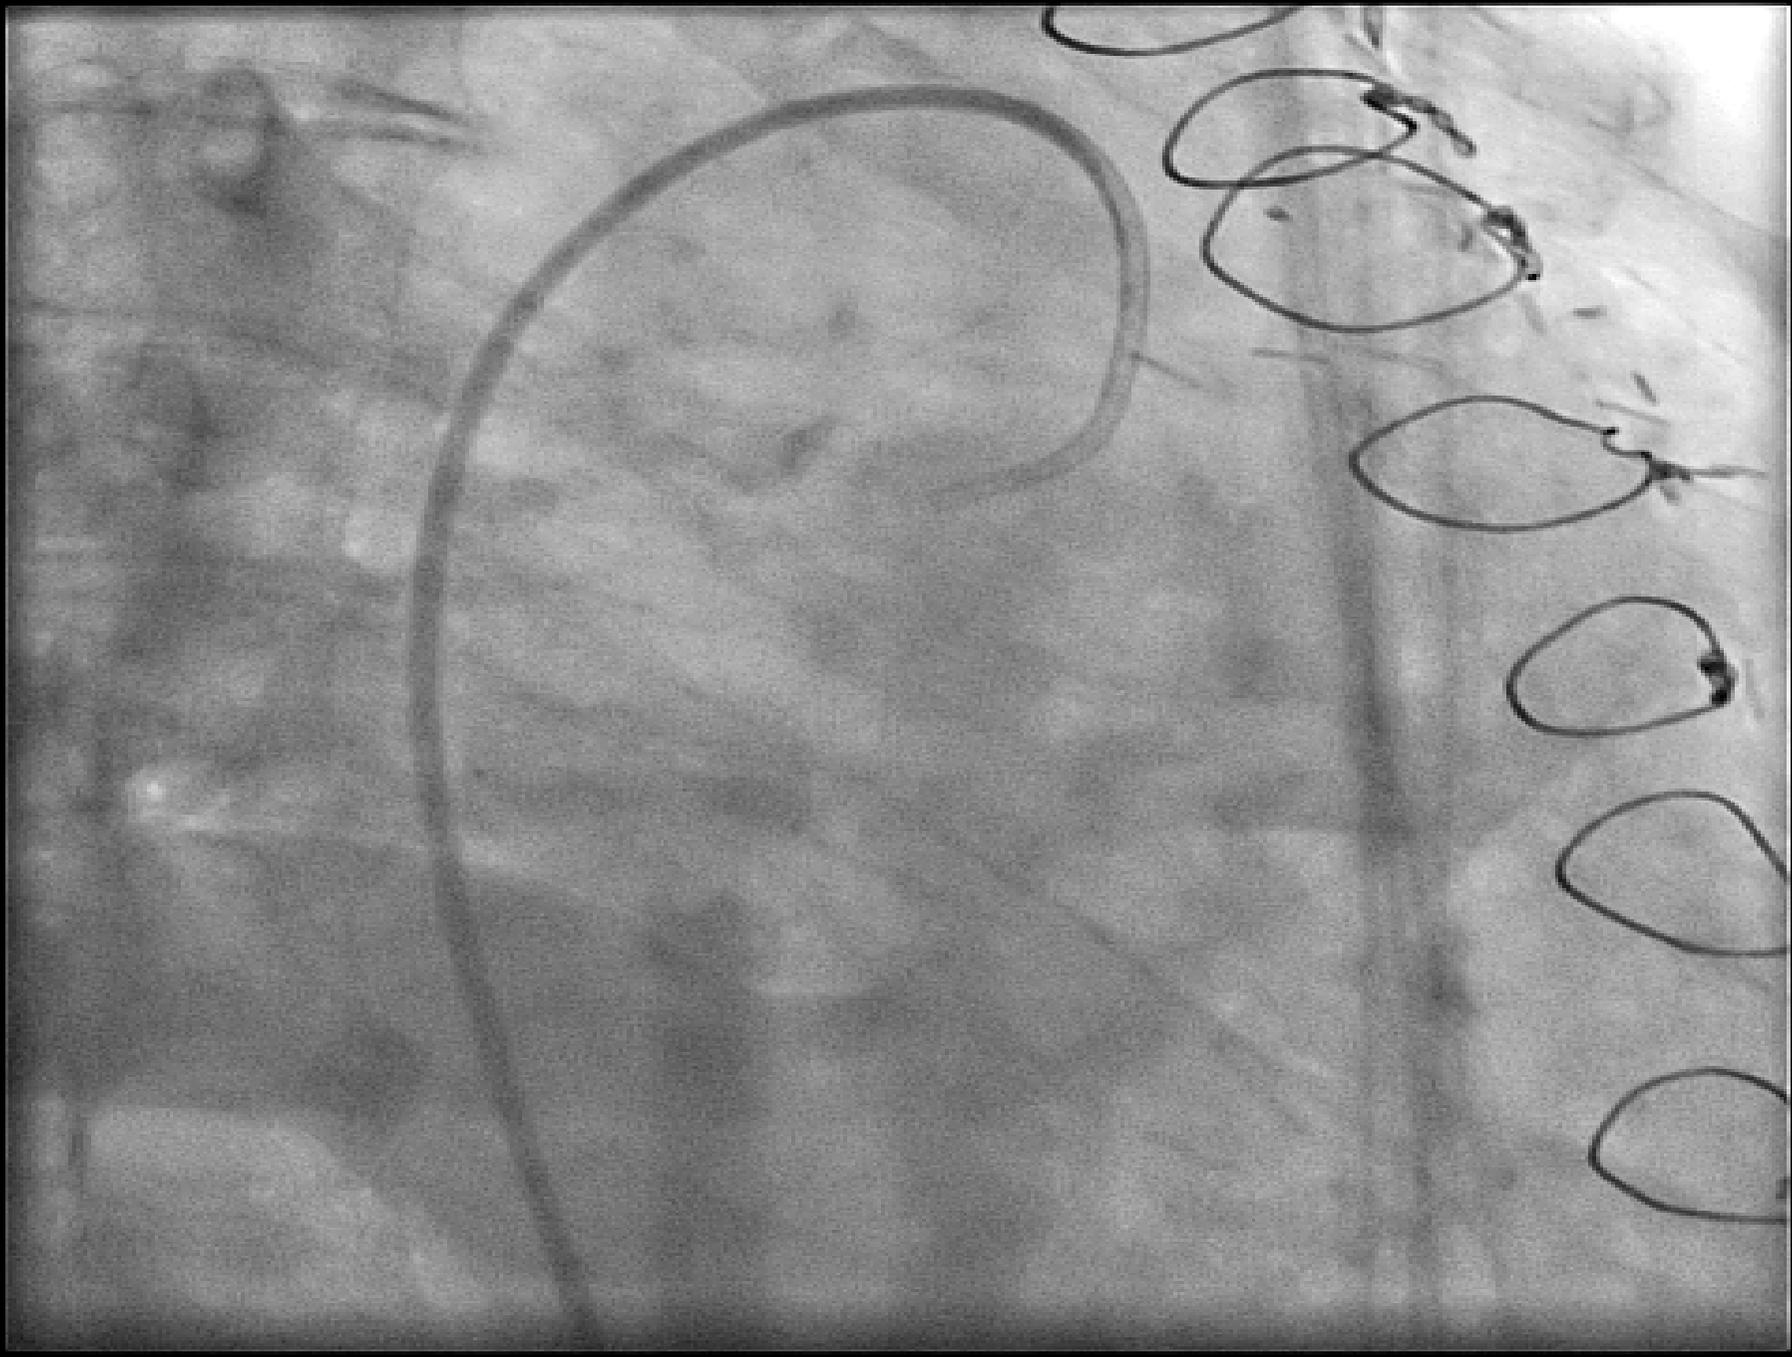

1875
1876
1877
1878
1879

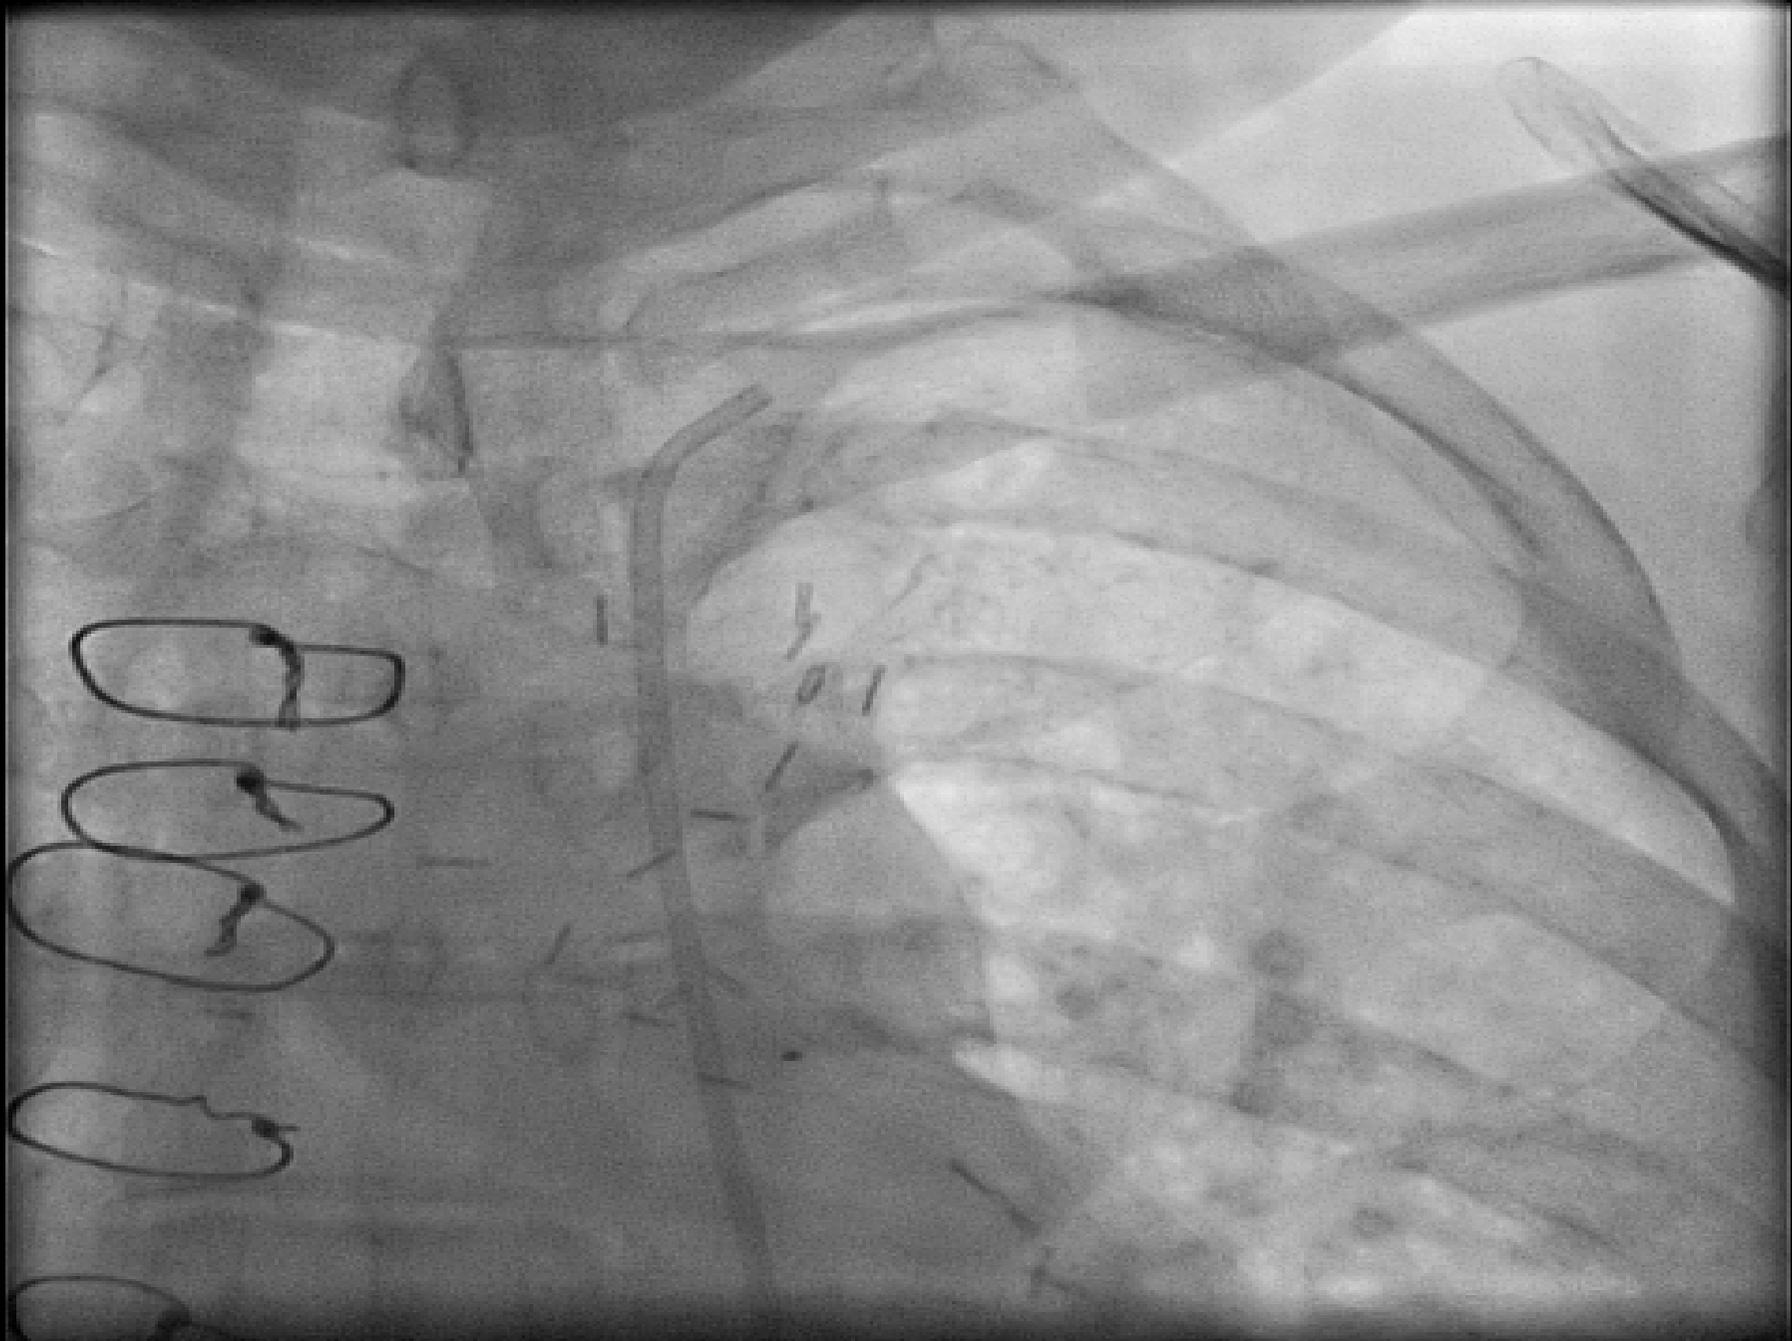

KARAR

- Kardiyovasküler cerrahi ile yapılan konsey sonucunda LAD lezyona PCI yapılmasına karar verildi.
- Hastaya klopidogrel başlandı.
- KAG den 5gün sonra LAD lezyona PCI için hasta tekrar laboratuara alındı.

PKG


- Sol sisteme: 7F EBU 4 guiding kateter
- Ao-safen-D₁ greftine: 6F JR 4 diagnostik kateter

- 
- ASAHI Corsair mikrokateter
 - Conquest Pro 9 guide wire

Asahi Corsair Microcatheter

Corsair OTW Support Hybrid Catheter / Septal Dilator for antegrade and retrograde approaches to CTO's:

- Distal segment hydrophilic coated
- Kink resistant tapered tip (.016")
- Ease in crossing and dilating micro-channels or lesions
- Improves wire support and wire manipulation

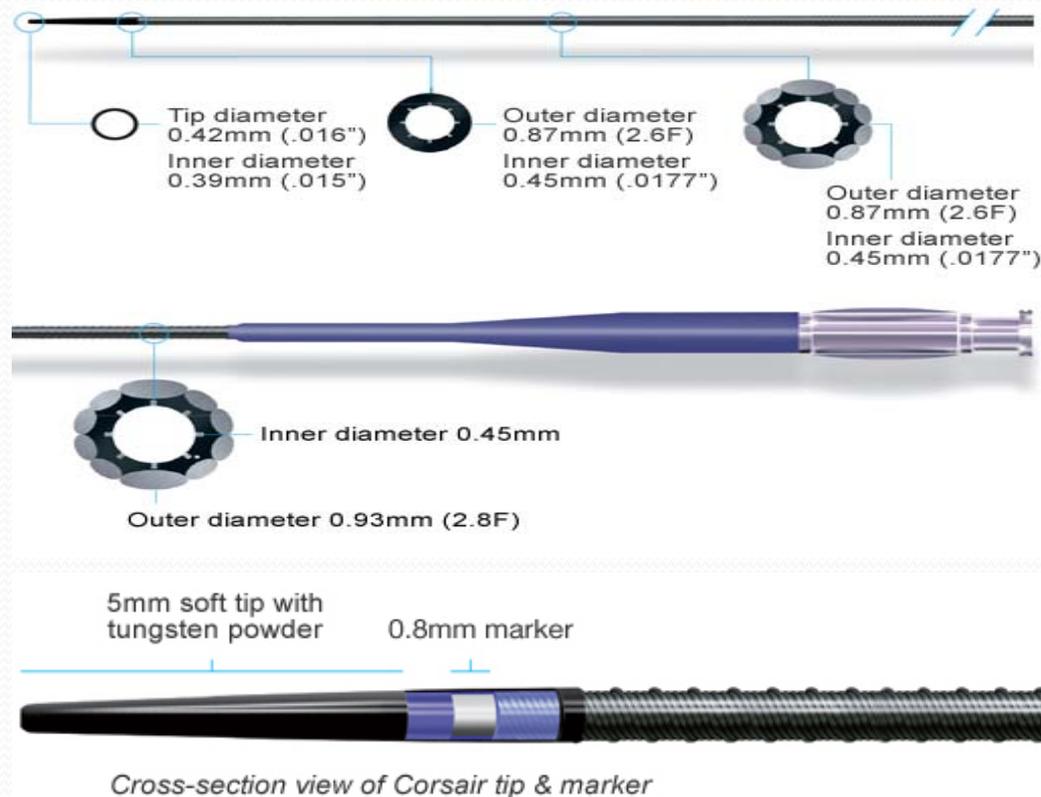



ASAHI Conquest Pro


- Tip load 9.0 g
- Tip radiopacity 20 cm
- Tip outer diameter 0.009 inch (0.23 mm)
- SLIP COAT® coating over the spring coil
- PTFE coating over the shaft

SLIP COAT® coating for lubricity and tapered to 0.009"(0.23mm) at the tip. The 9g stiff, tapered tip helps to engage micro channels and to penetrate highly stenosed lesions. The distal tip is not coated to allow it to catch on the entry point of the lesions.


Conquest Pro AGH143090

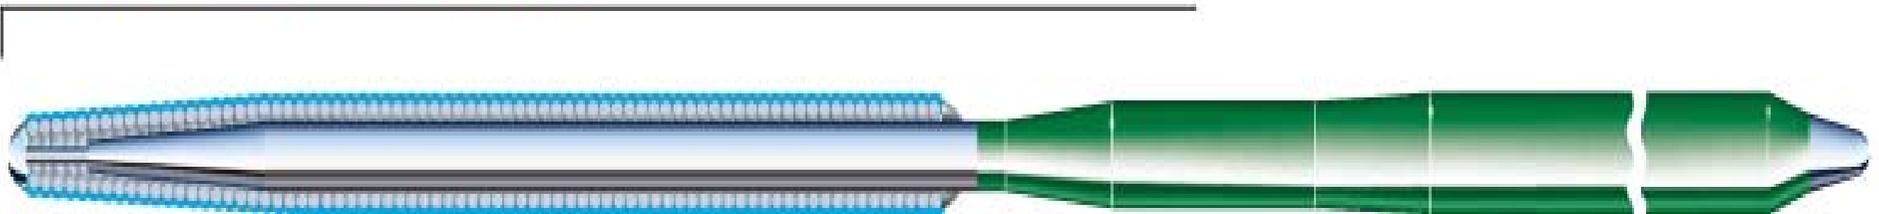

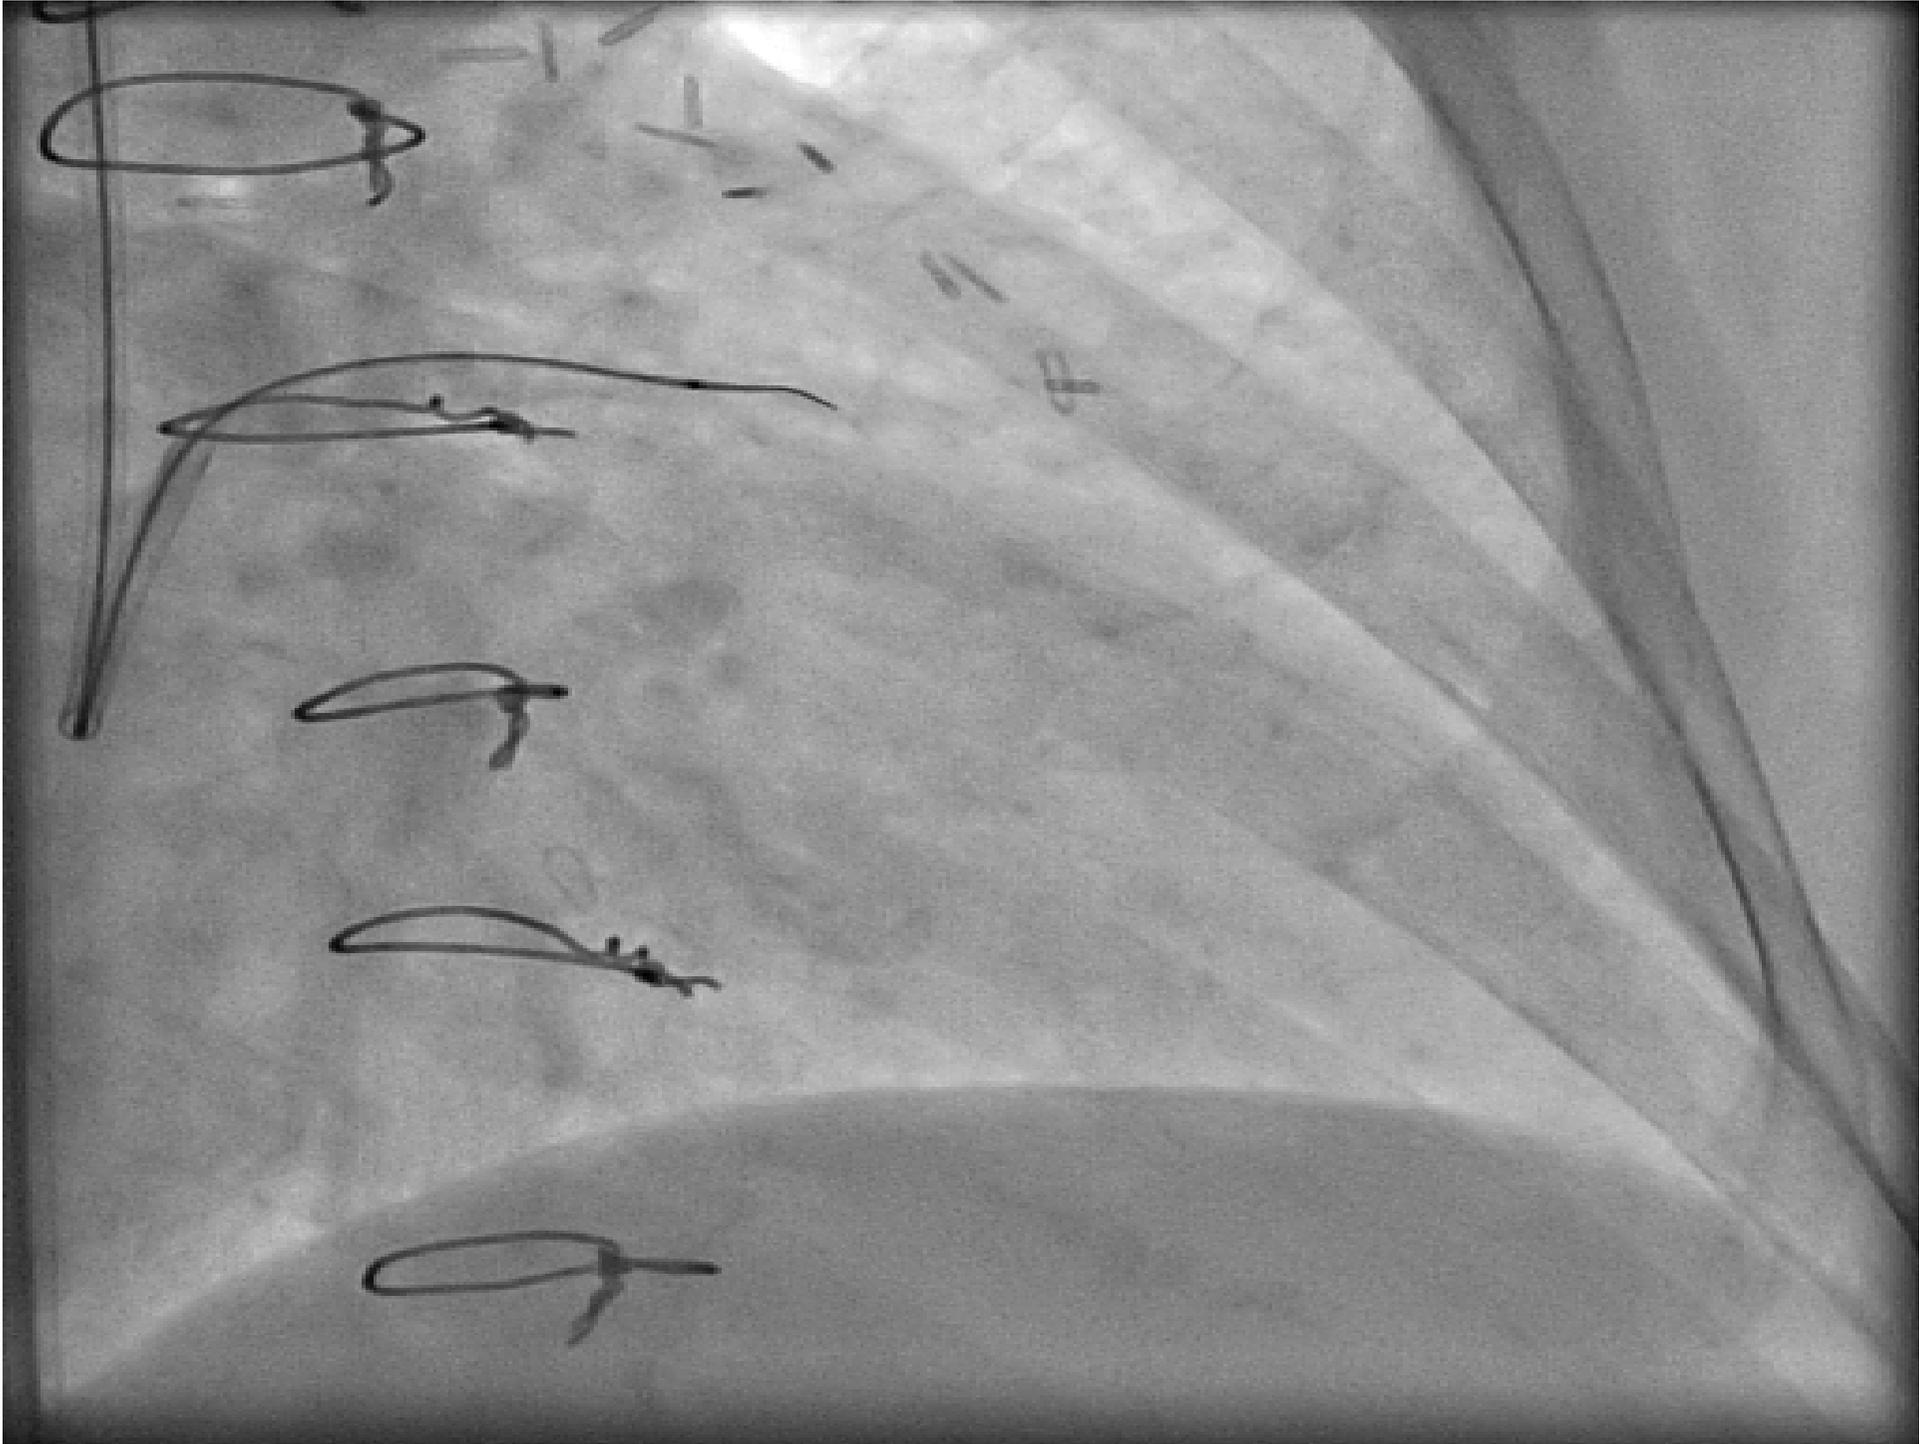

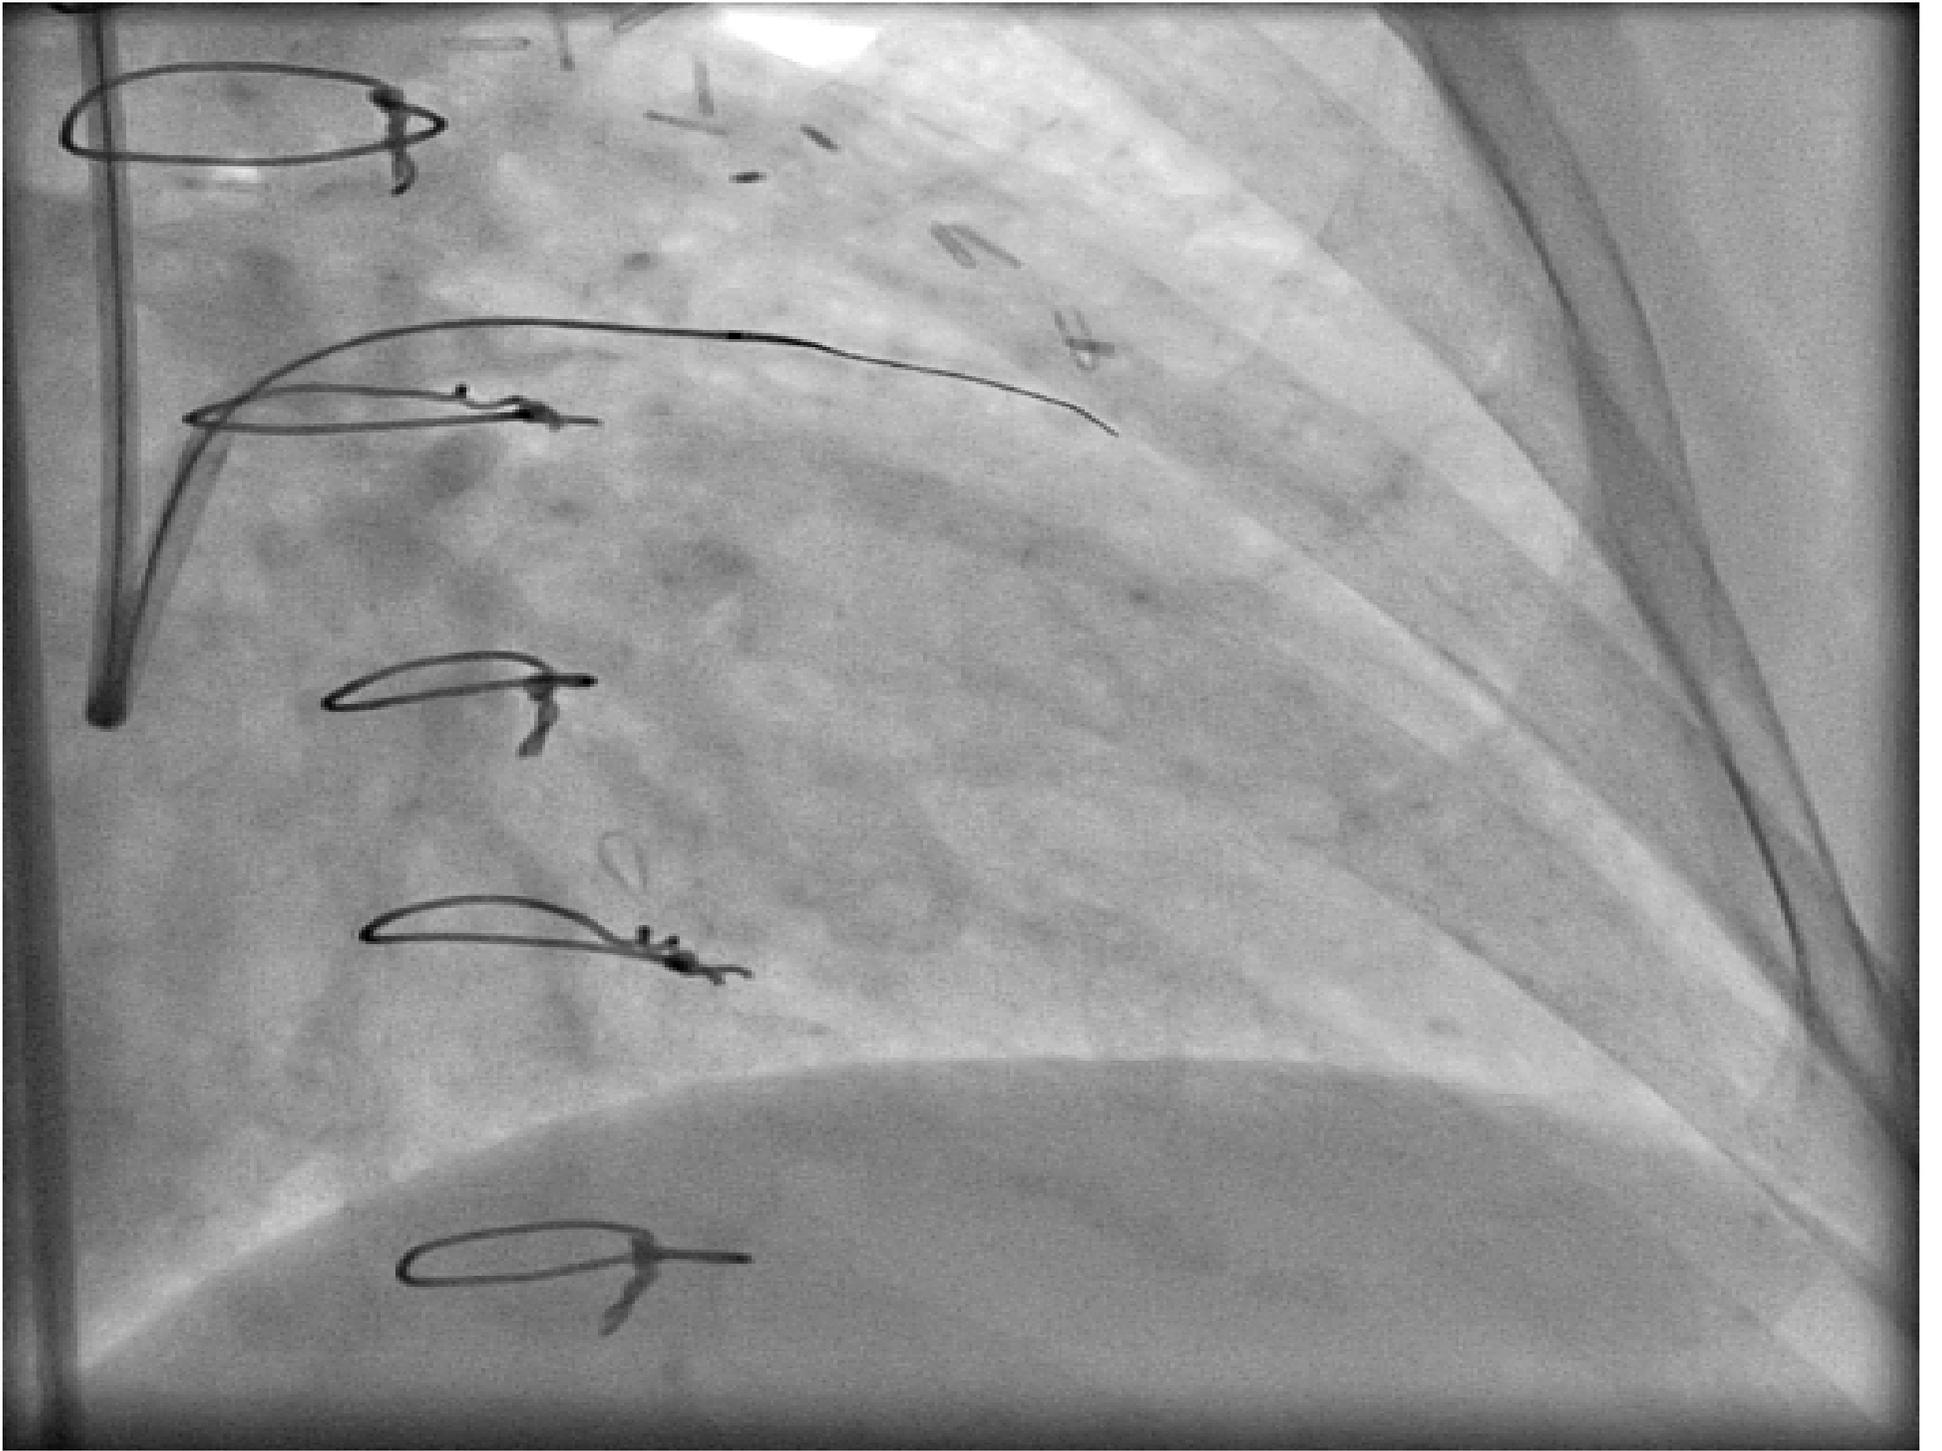



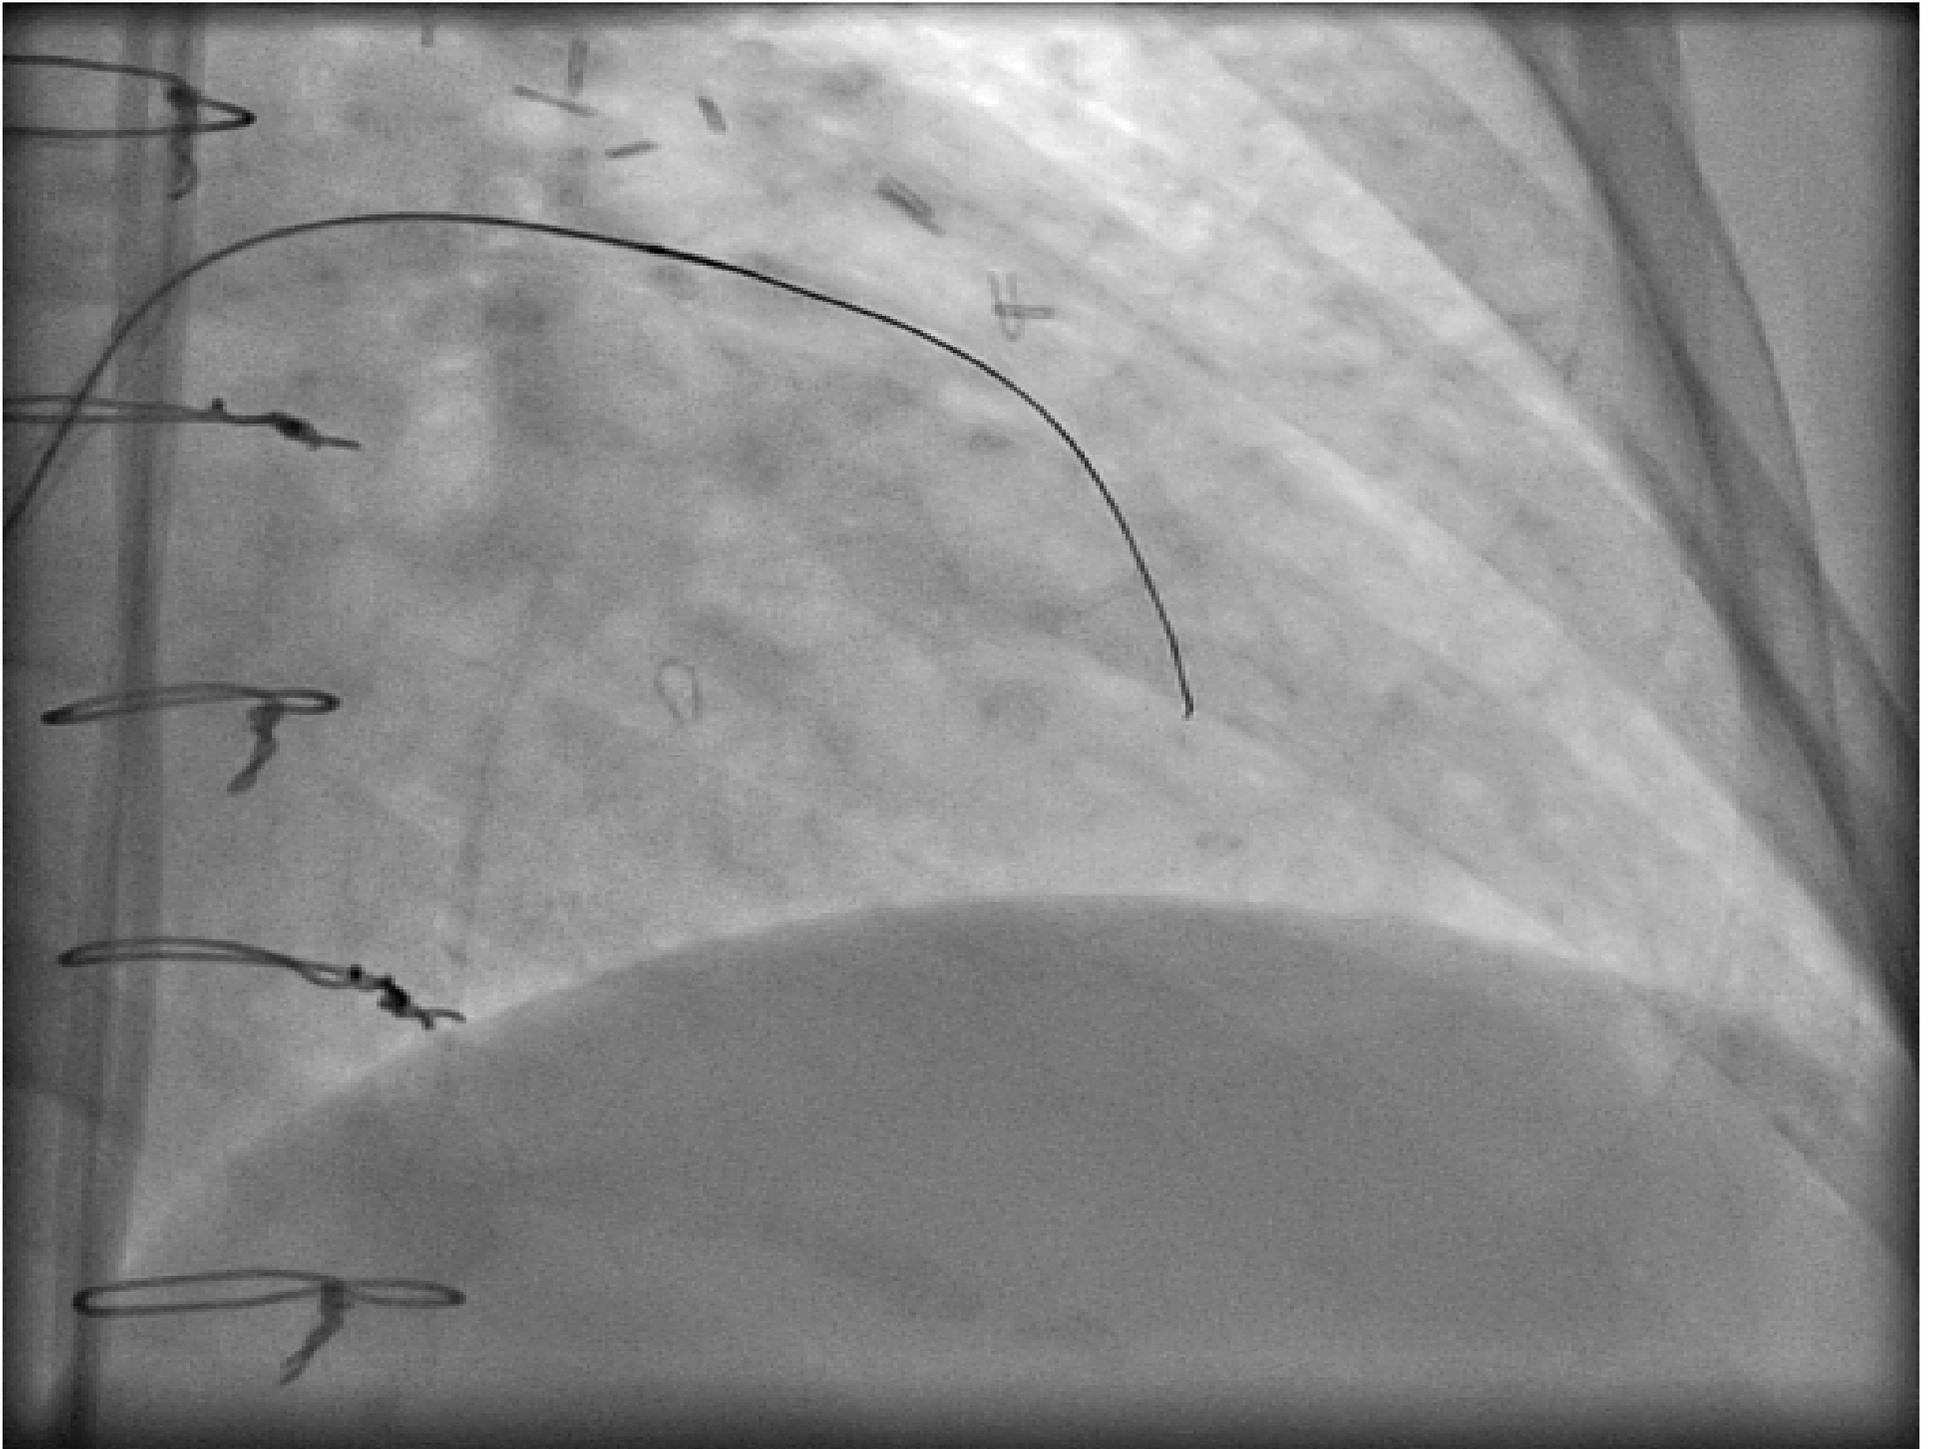


- Corsair mikrokateterin vidalama tekniđi ile lezyona penetrasyonuna alıřılırken, kilitlenme hissi
- Kateter geriye dođru alınmaya alıřılırken aniden serbestleşme gerekleşti.
- Kateterin ucundan küçük bir paranın koptuđu ve telin üzerinde kaldıđı görüldü.
- Mikrokateter geriye alındı.
- Kılavuz tel üzerindeki kopan para ile kateter içine ekilerek dıřarı alındı.






- 
- İşleme hidrofilik PT₂ kılavuz tel ile devam edildi.

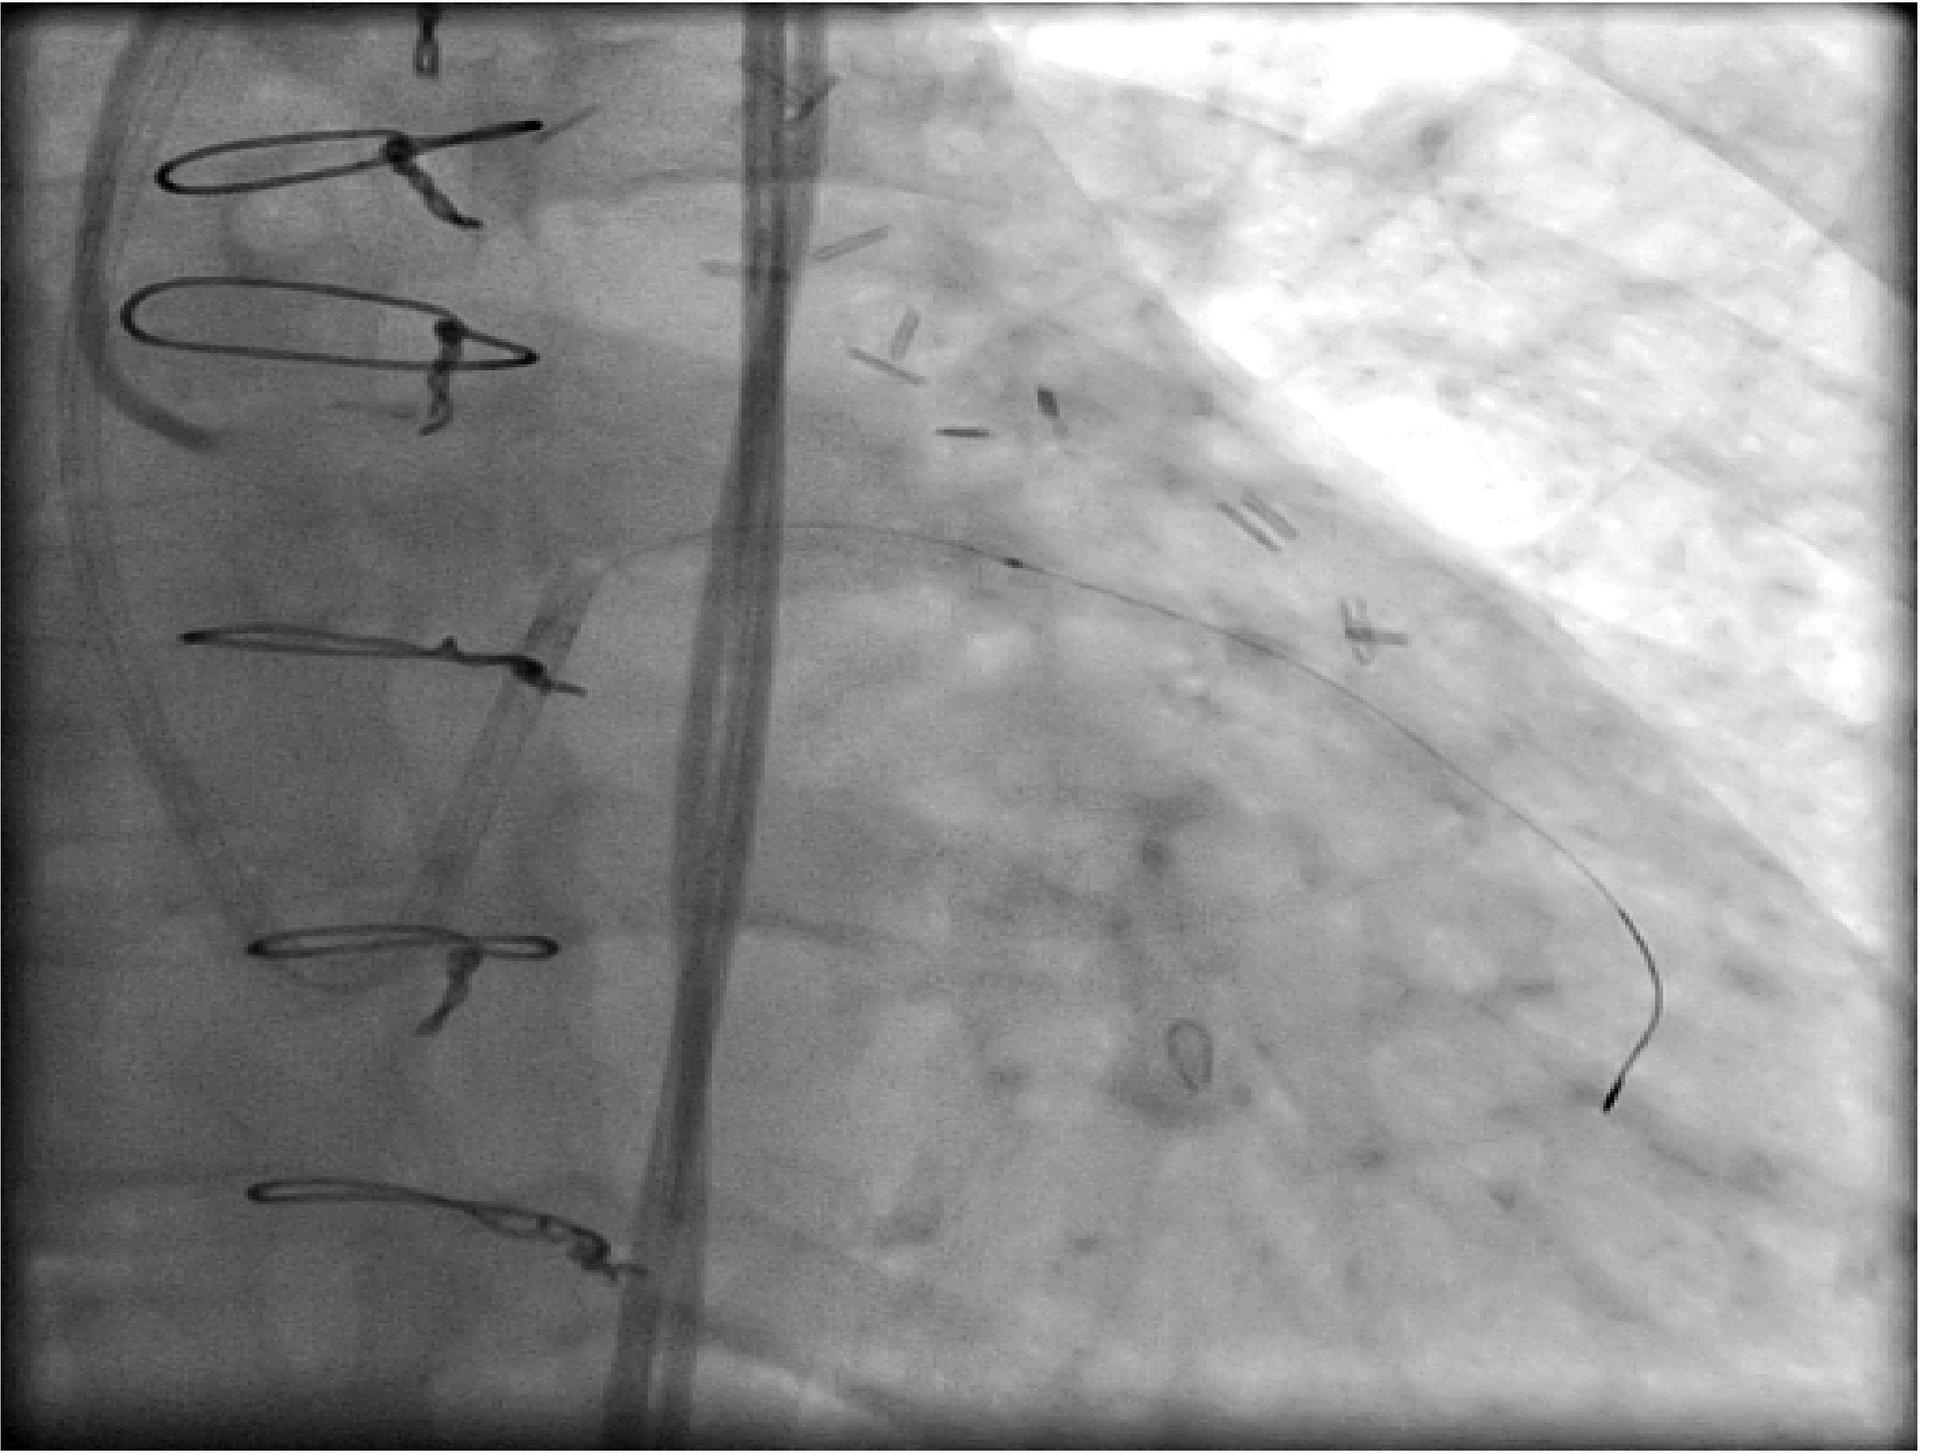



Handwritten text on the left page of an open notebook, consisting of five lines of cursive script. The text is difficult to decipher due to the dark, low-contrast image, but appears to be a list or series of entries.


Handwritten text on the right page of an open notebook. The text is very faint and illegible, appearing as light scribbles and lines. A vertical line is visible on the page, possibly indicating a margin or a section separator.


- 
- 1,25/ 15 mm balon
 - 2,0/ 20 mm balonlar ile predilatasyon

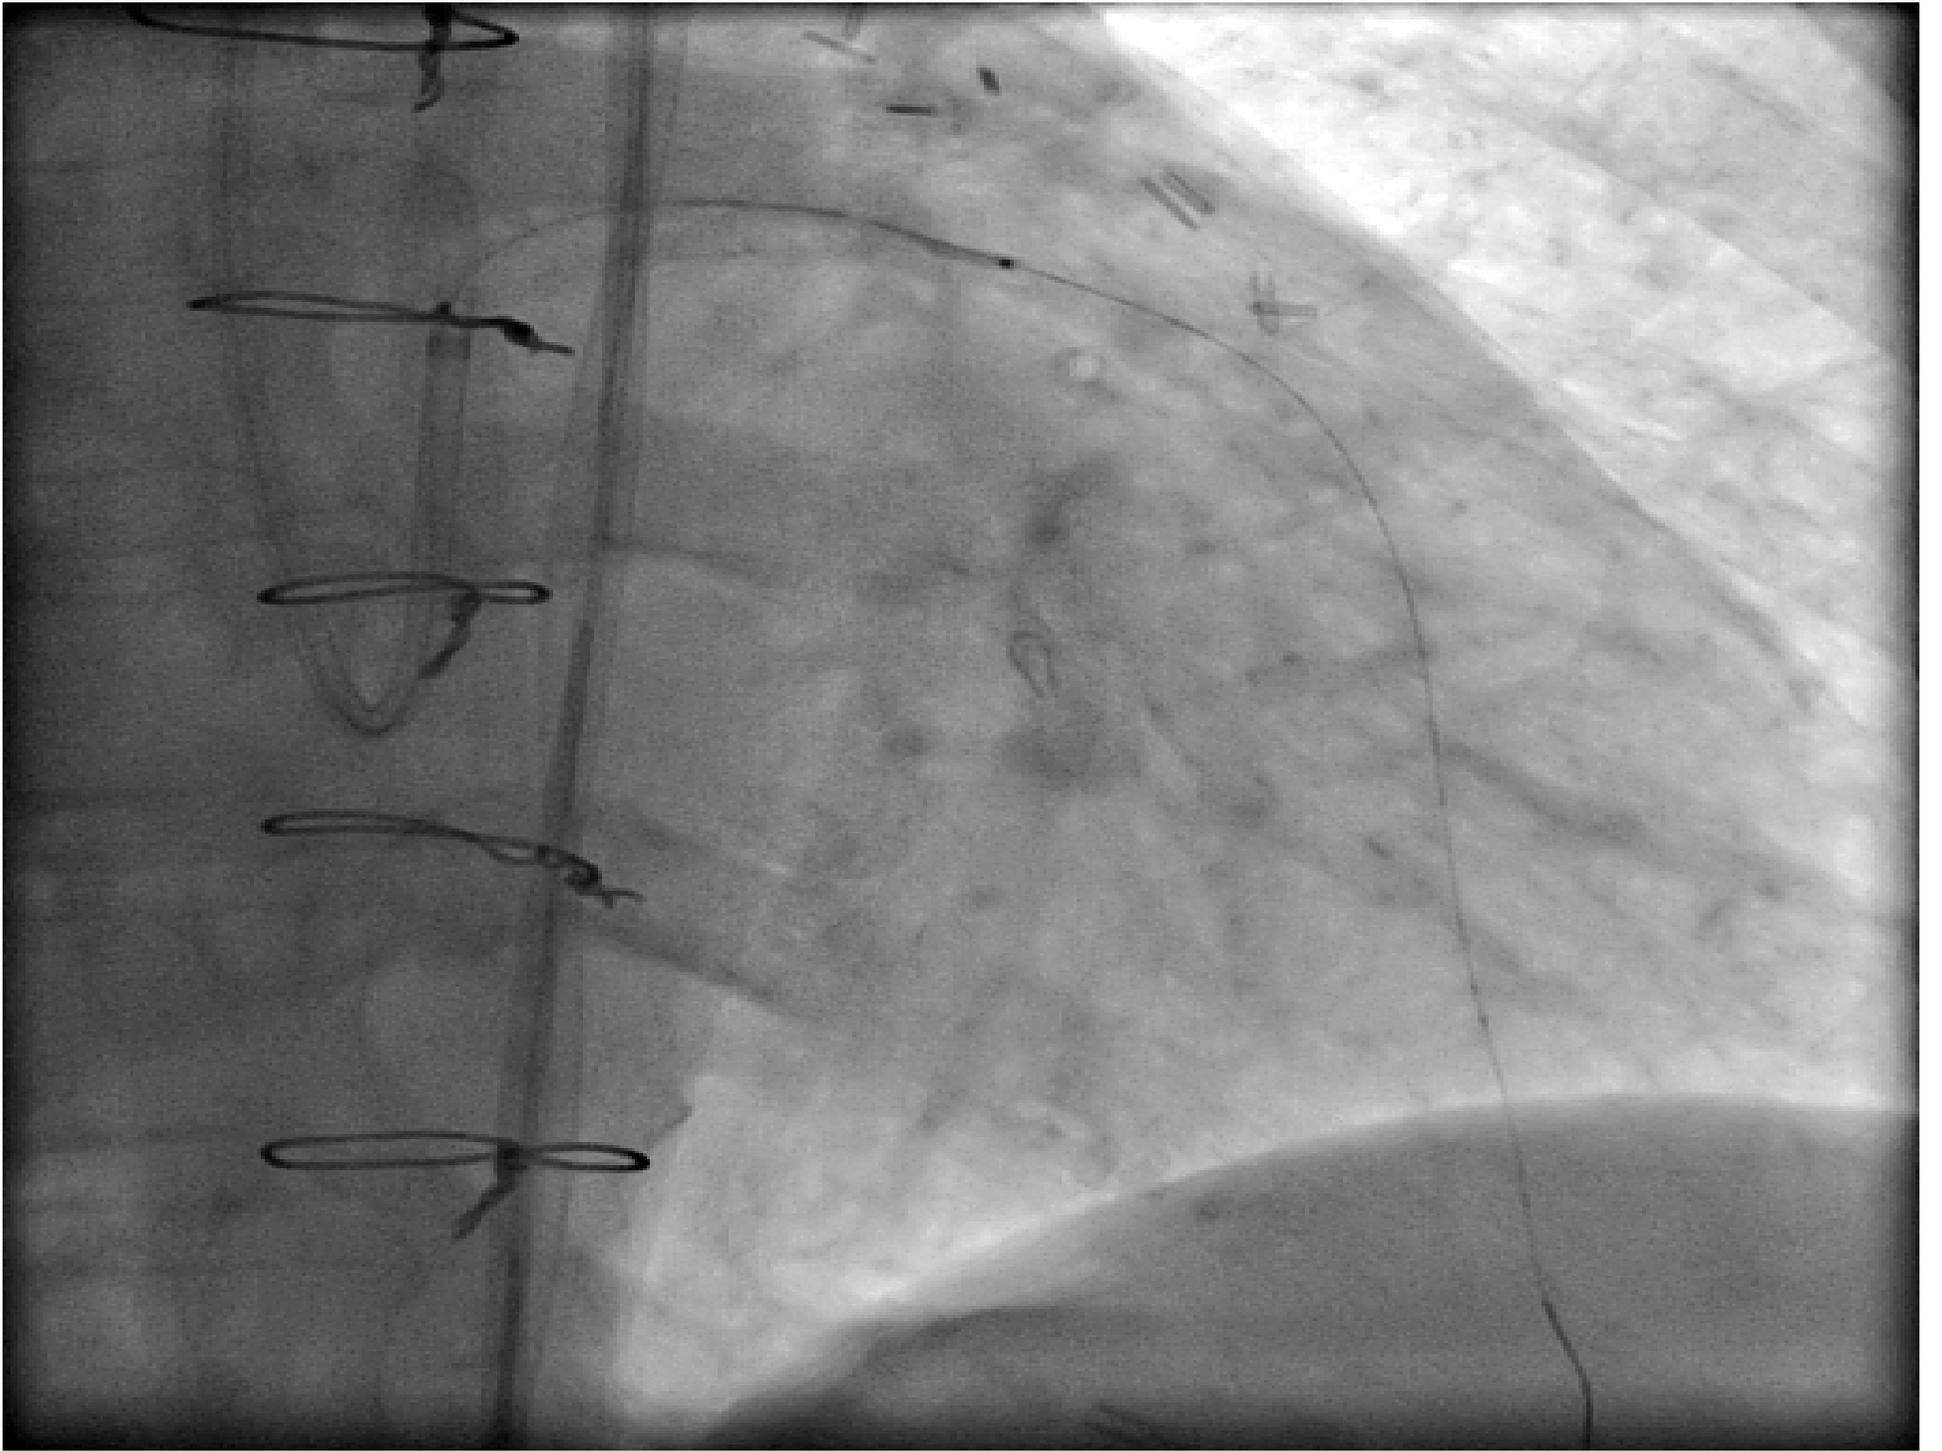


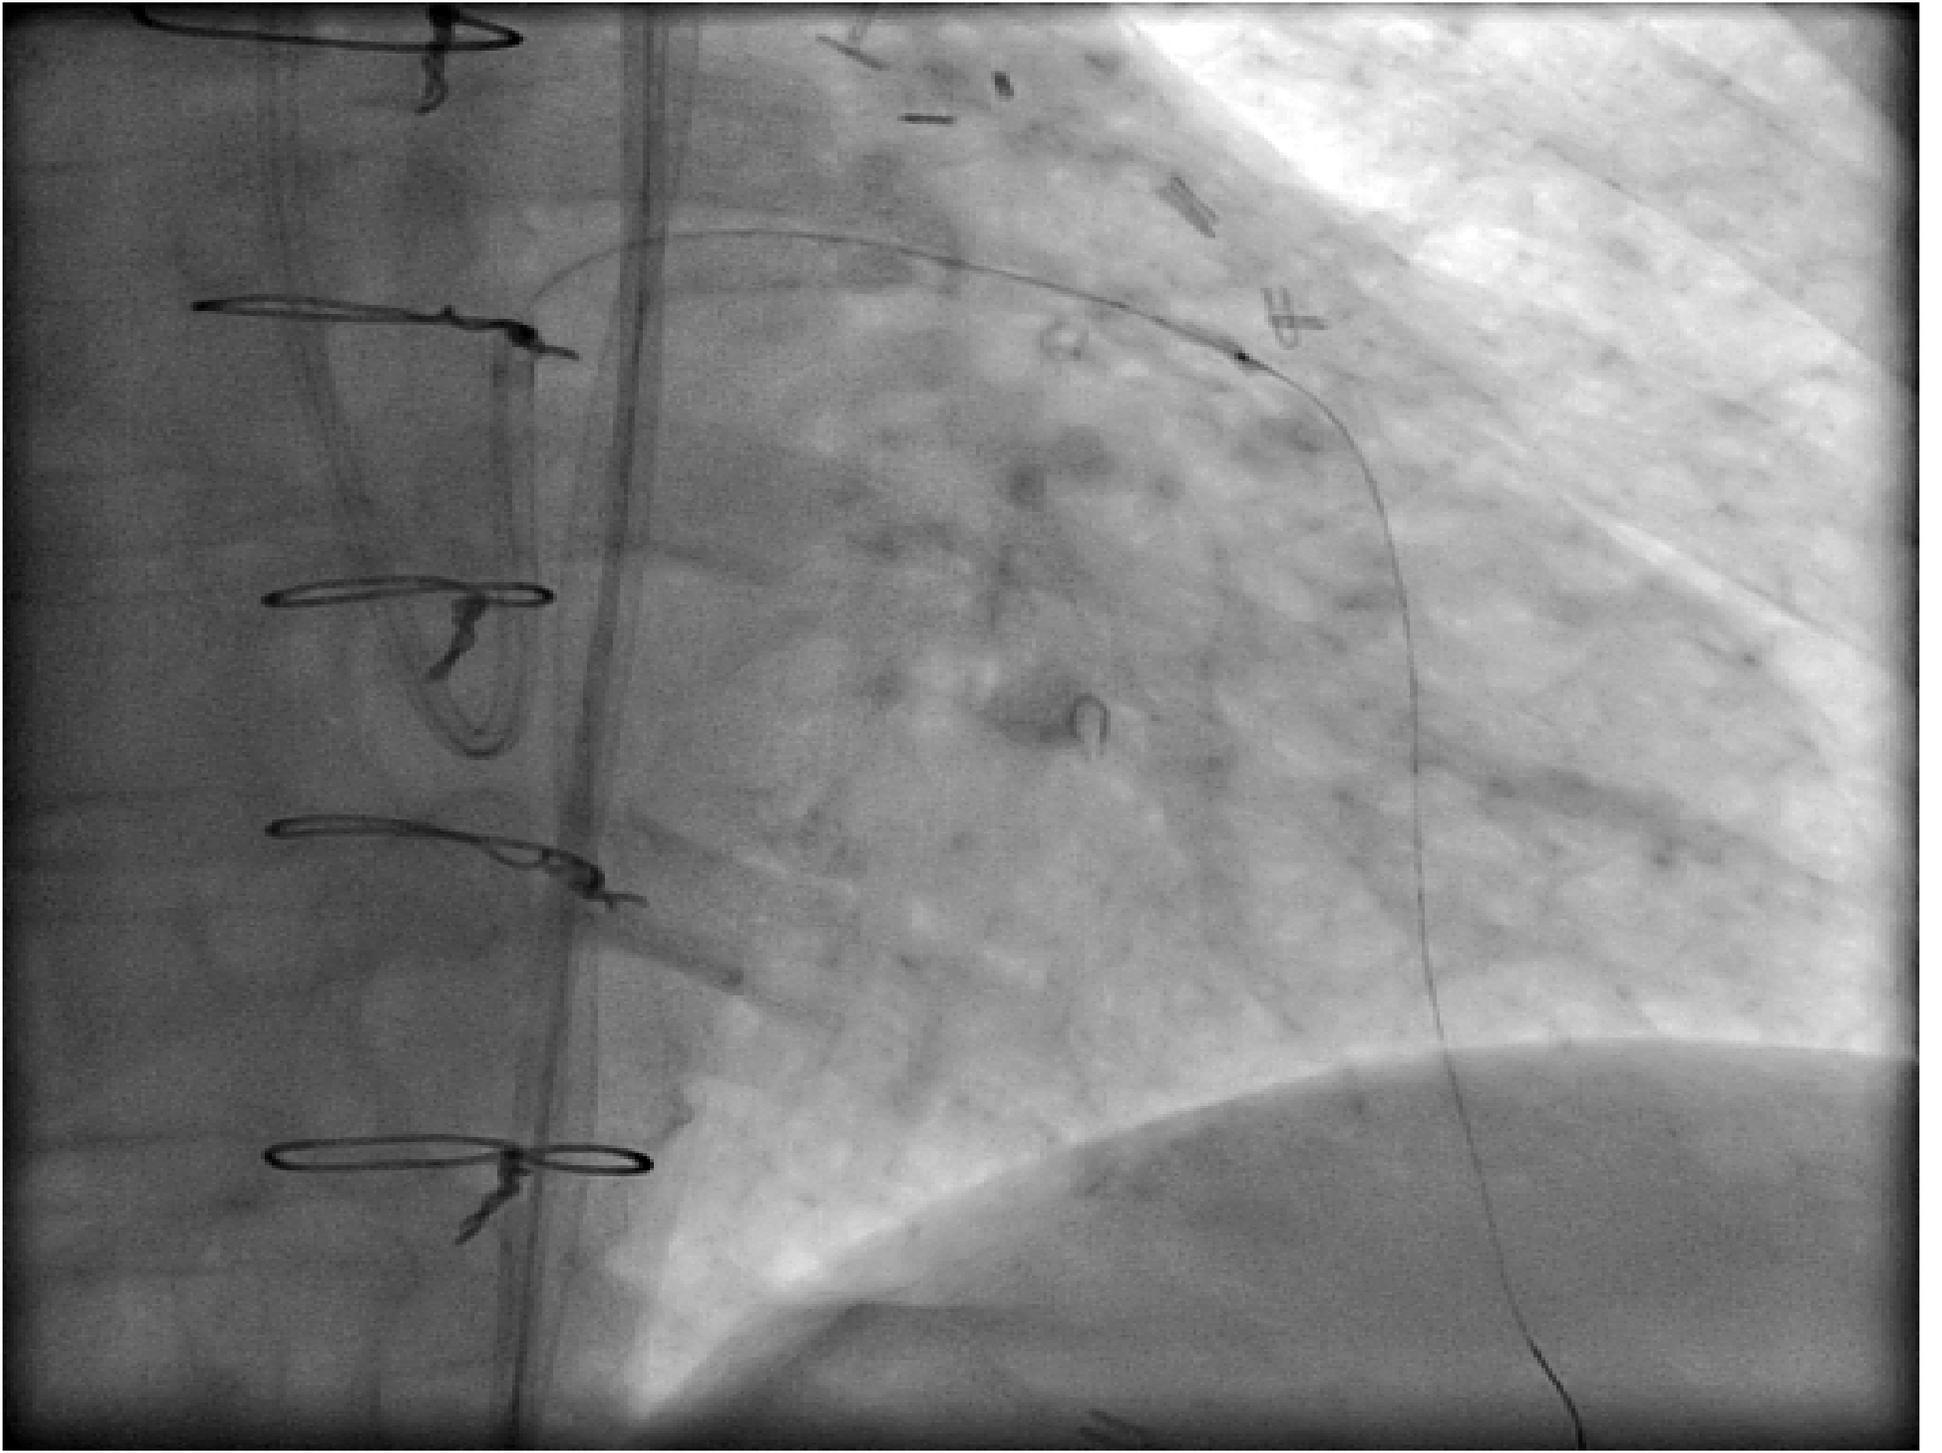


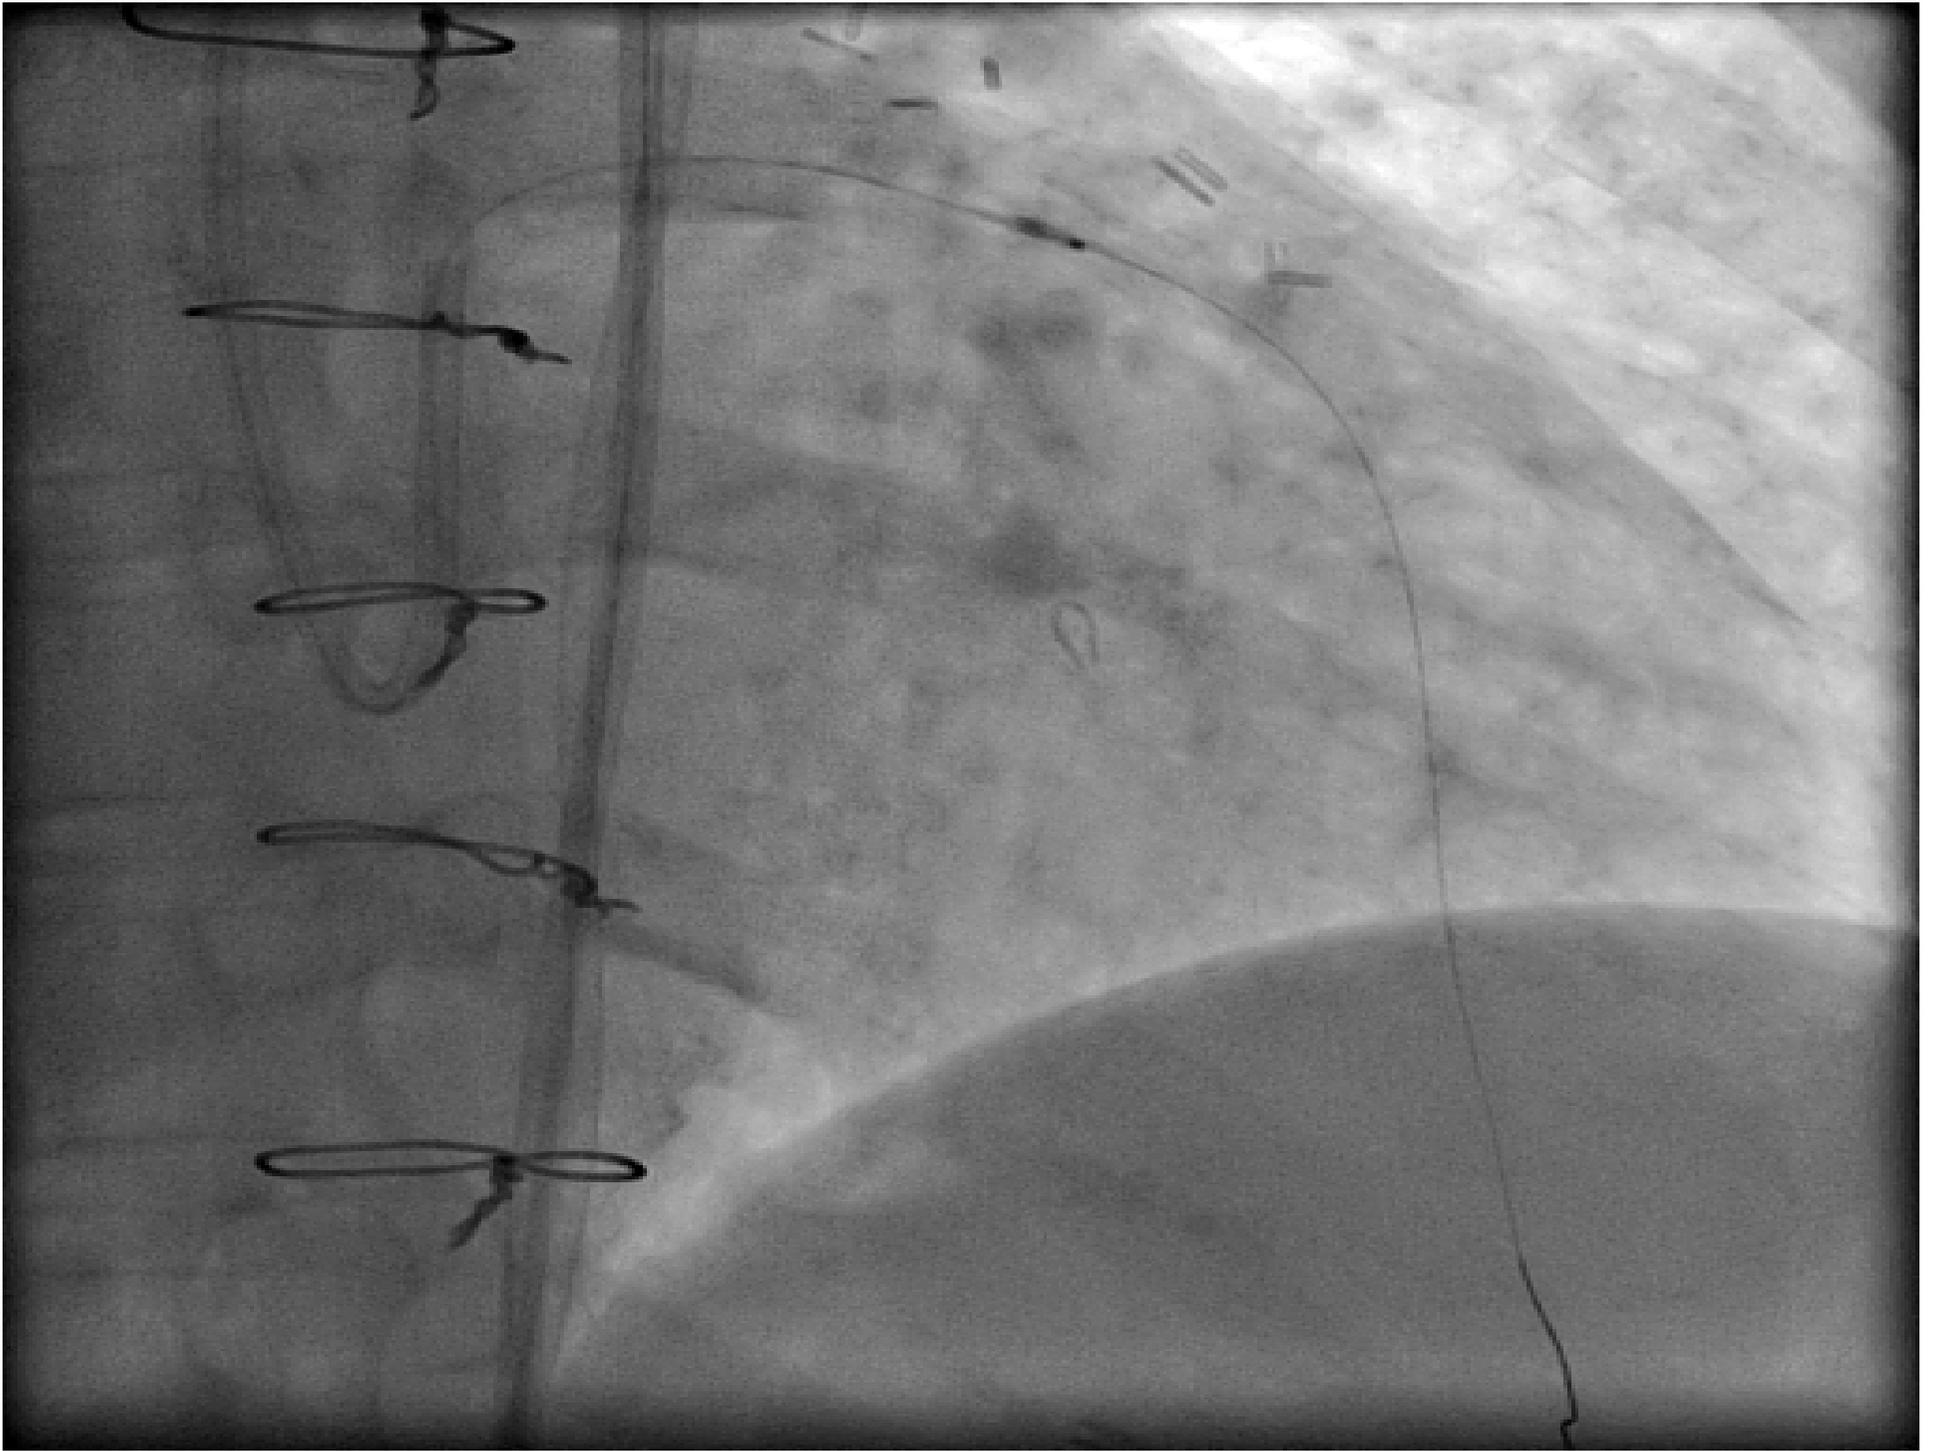

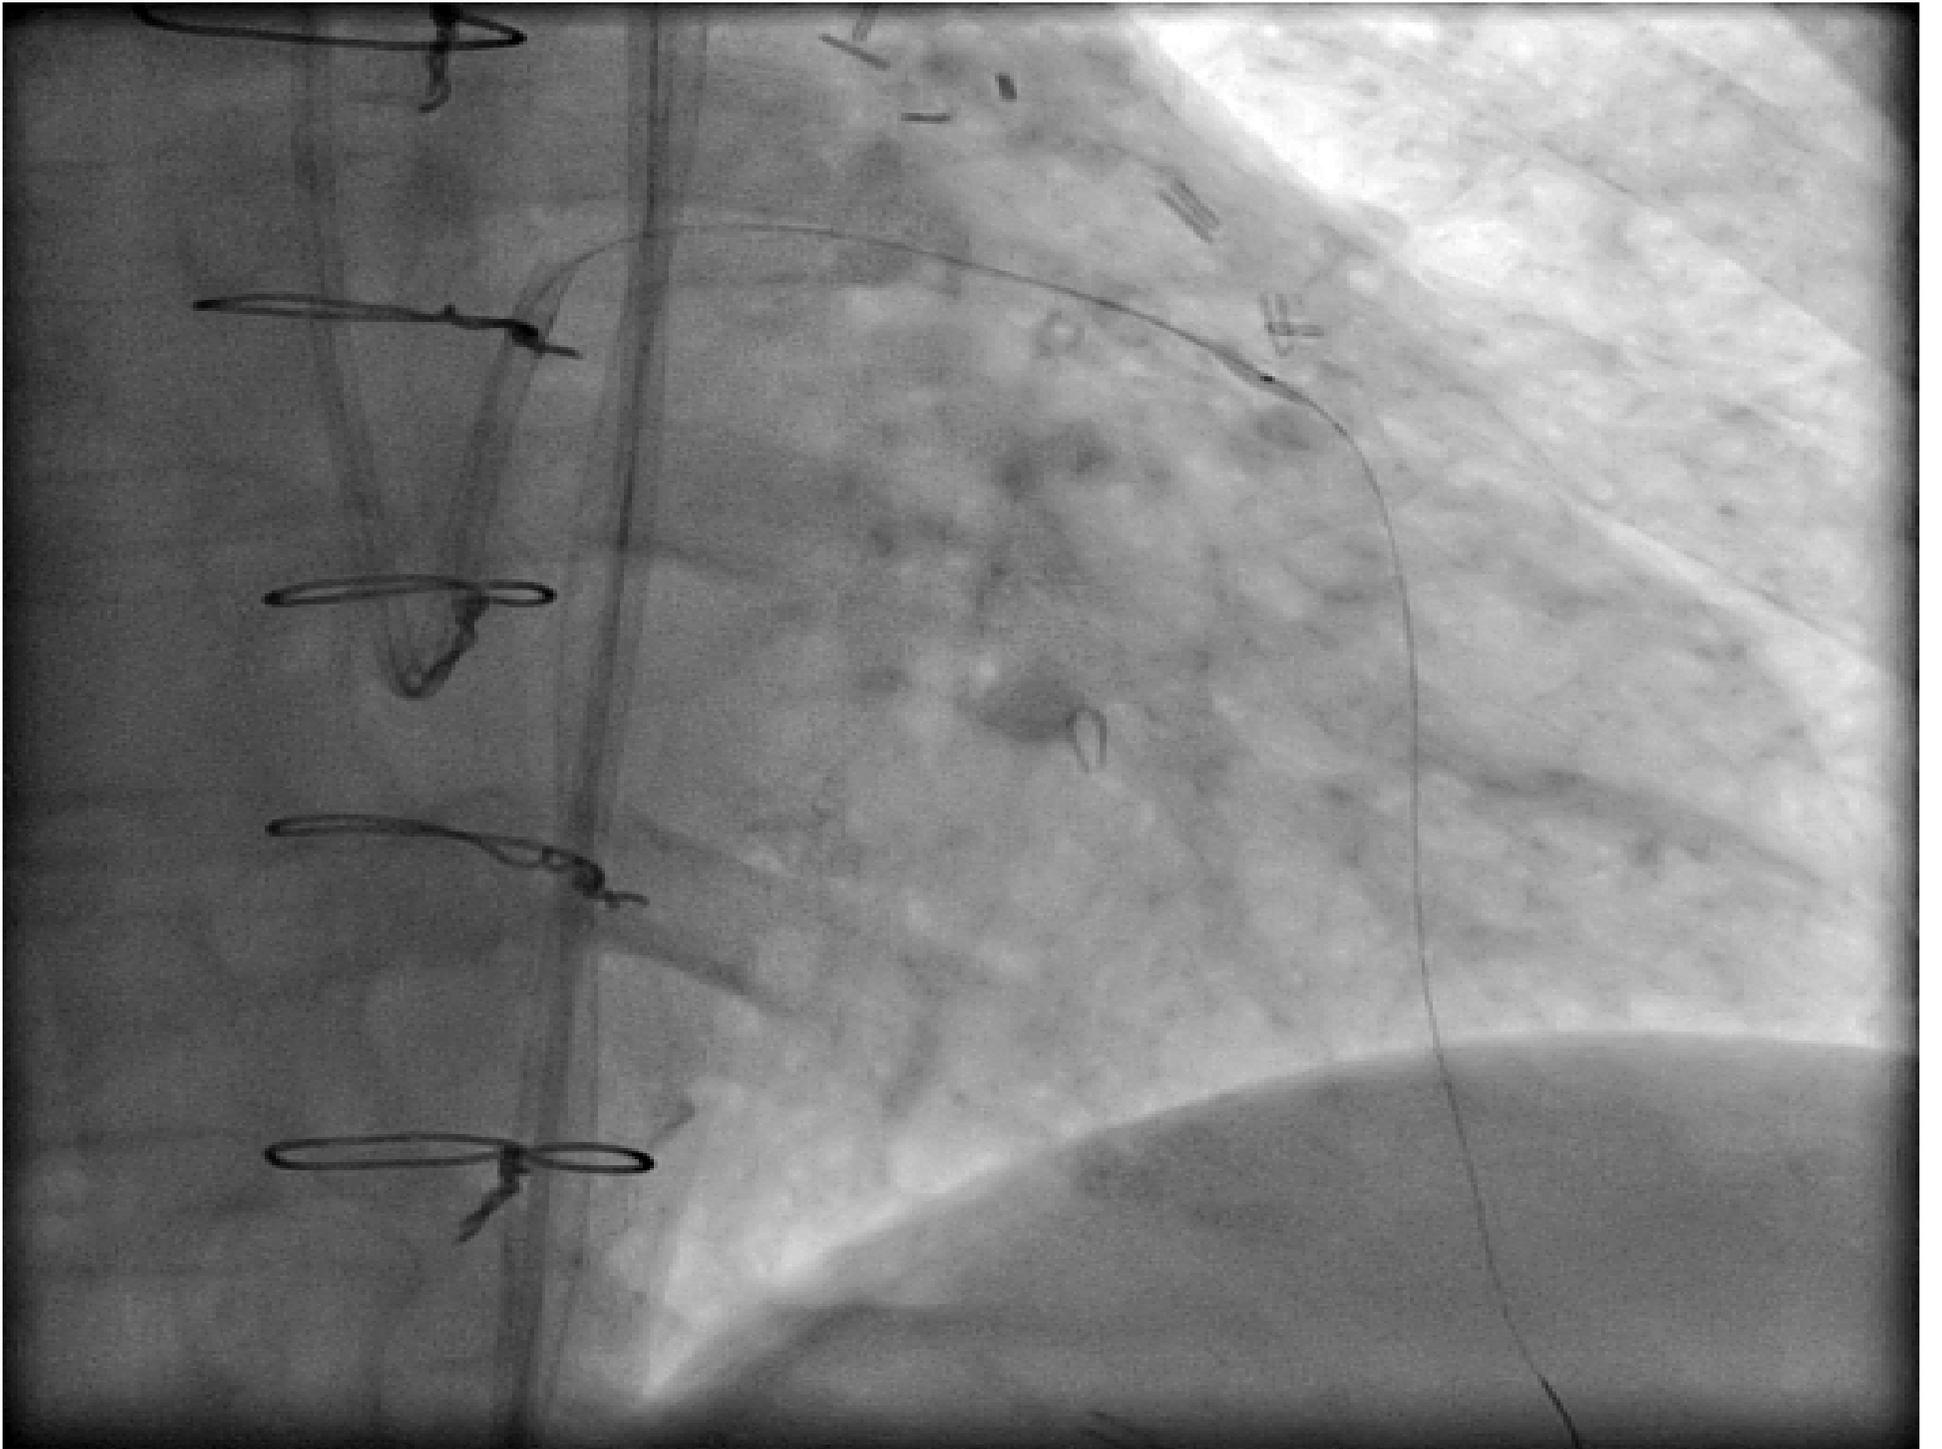


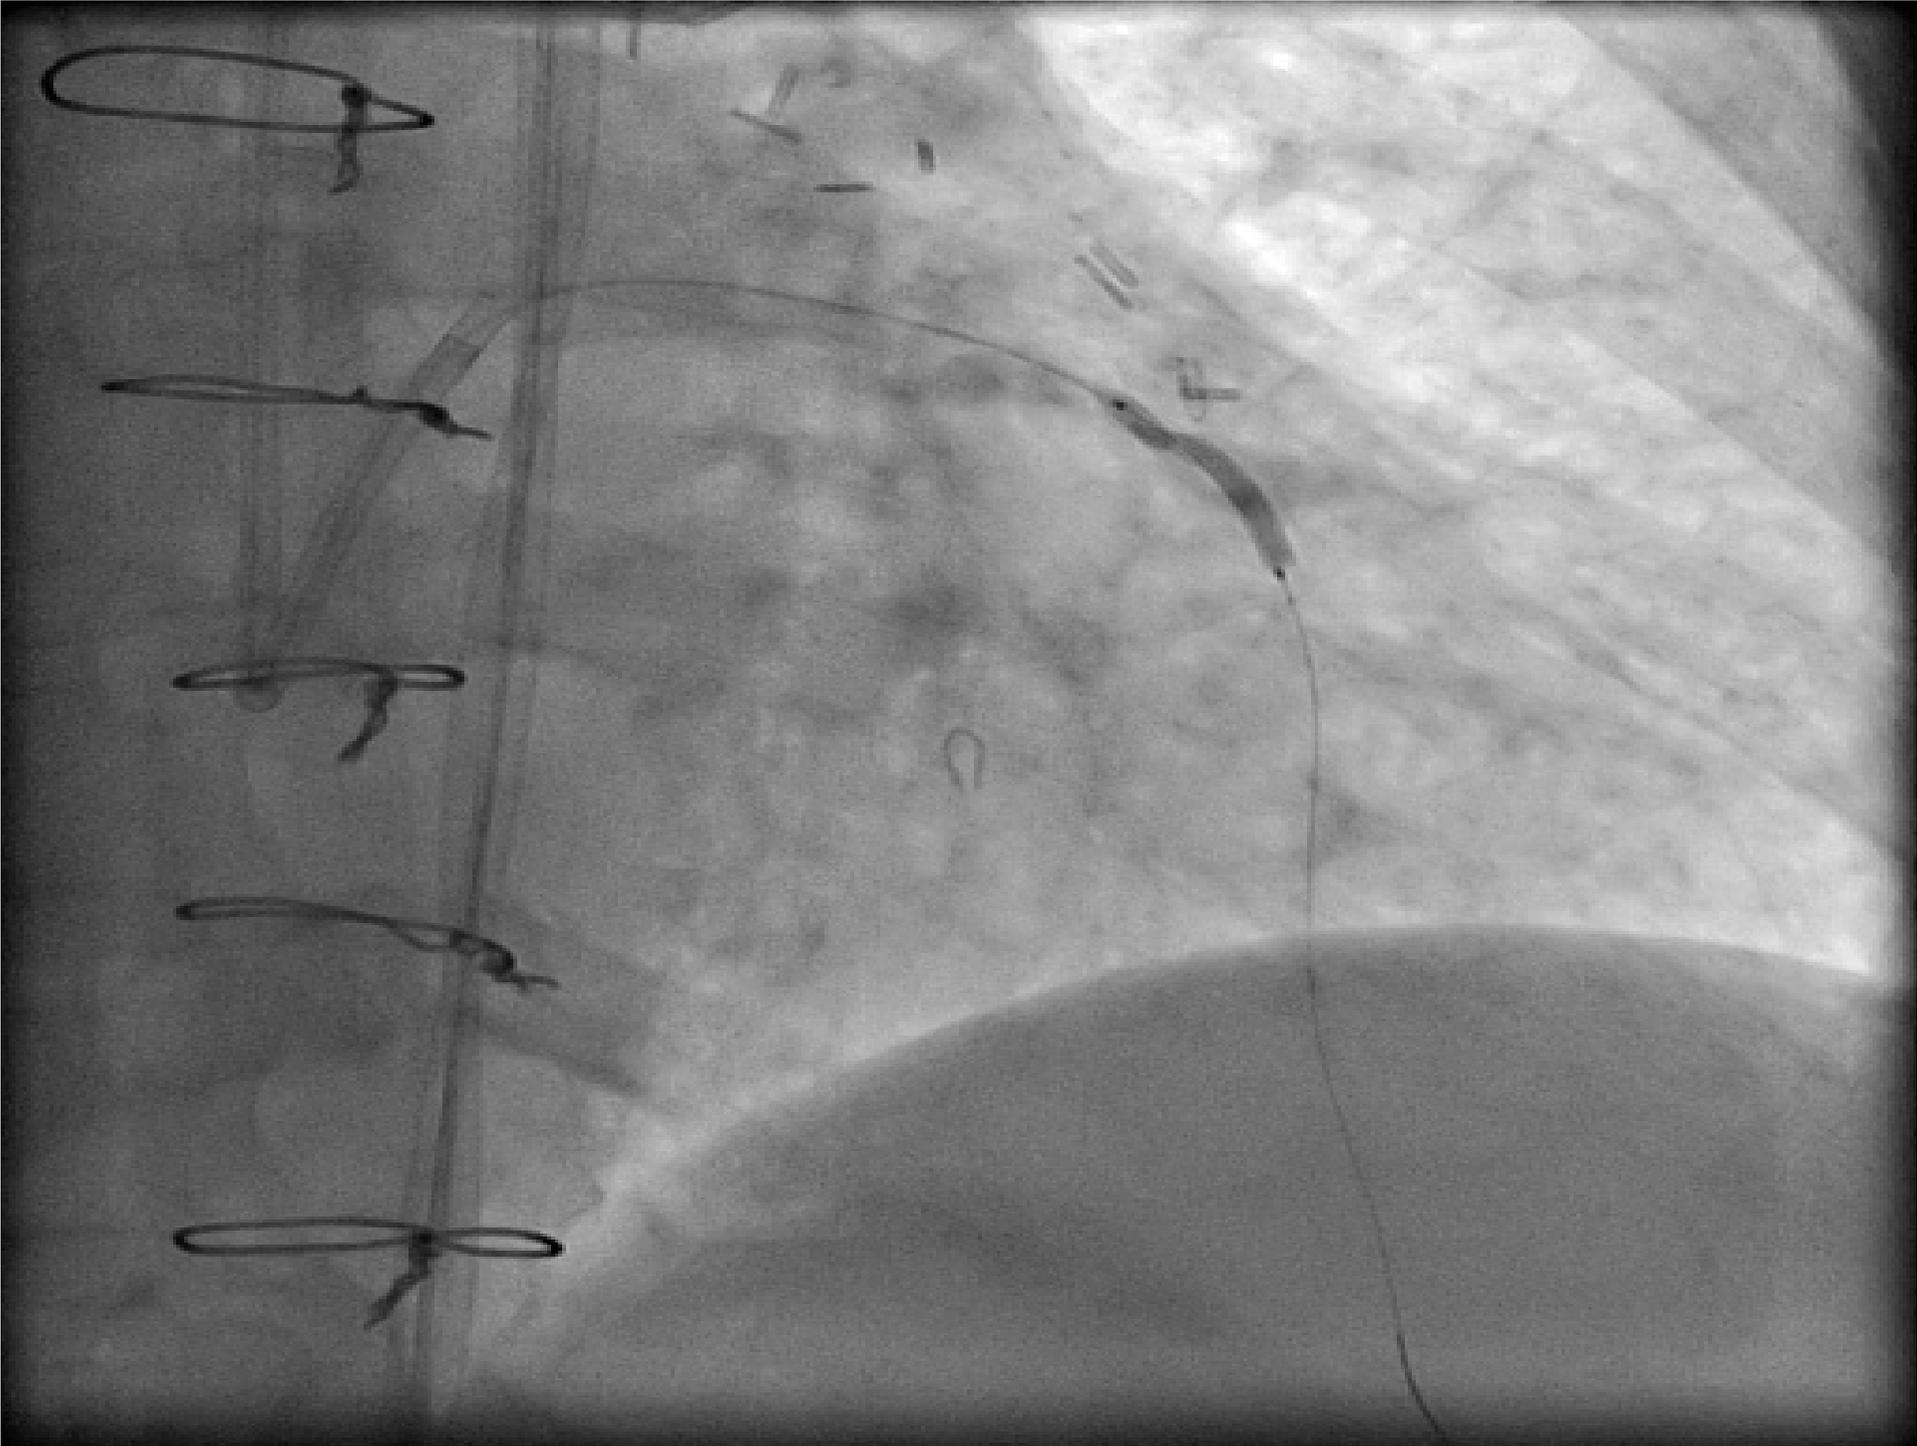


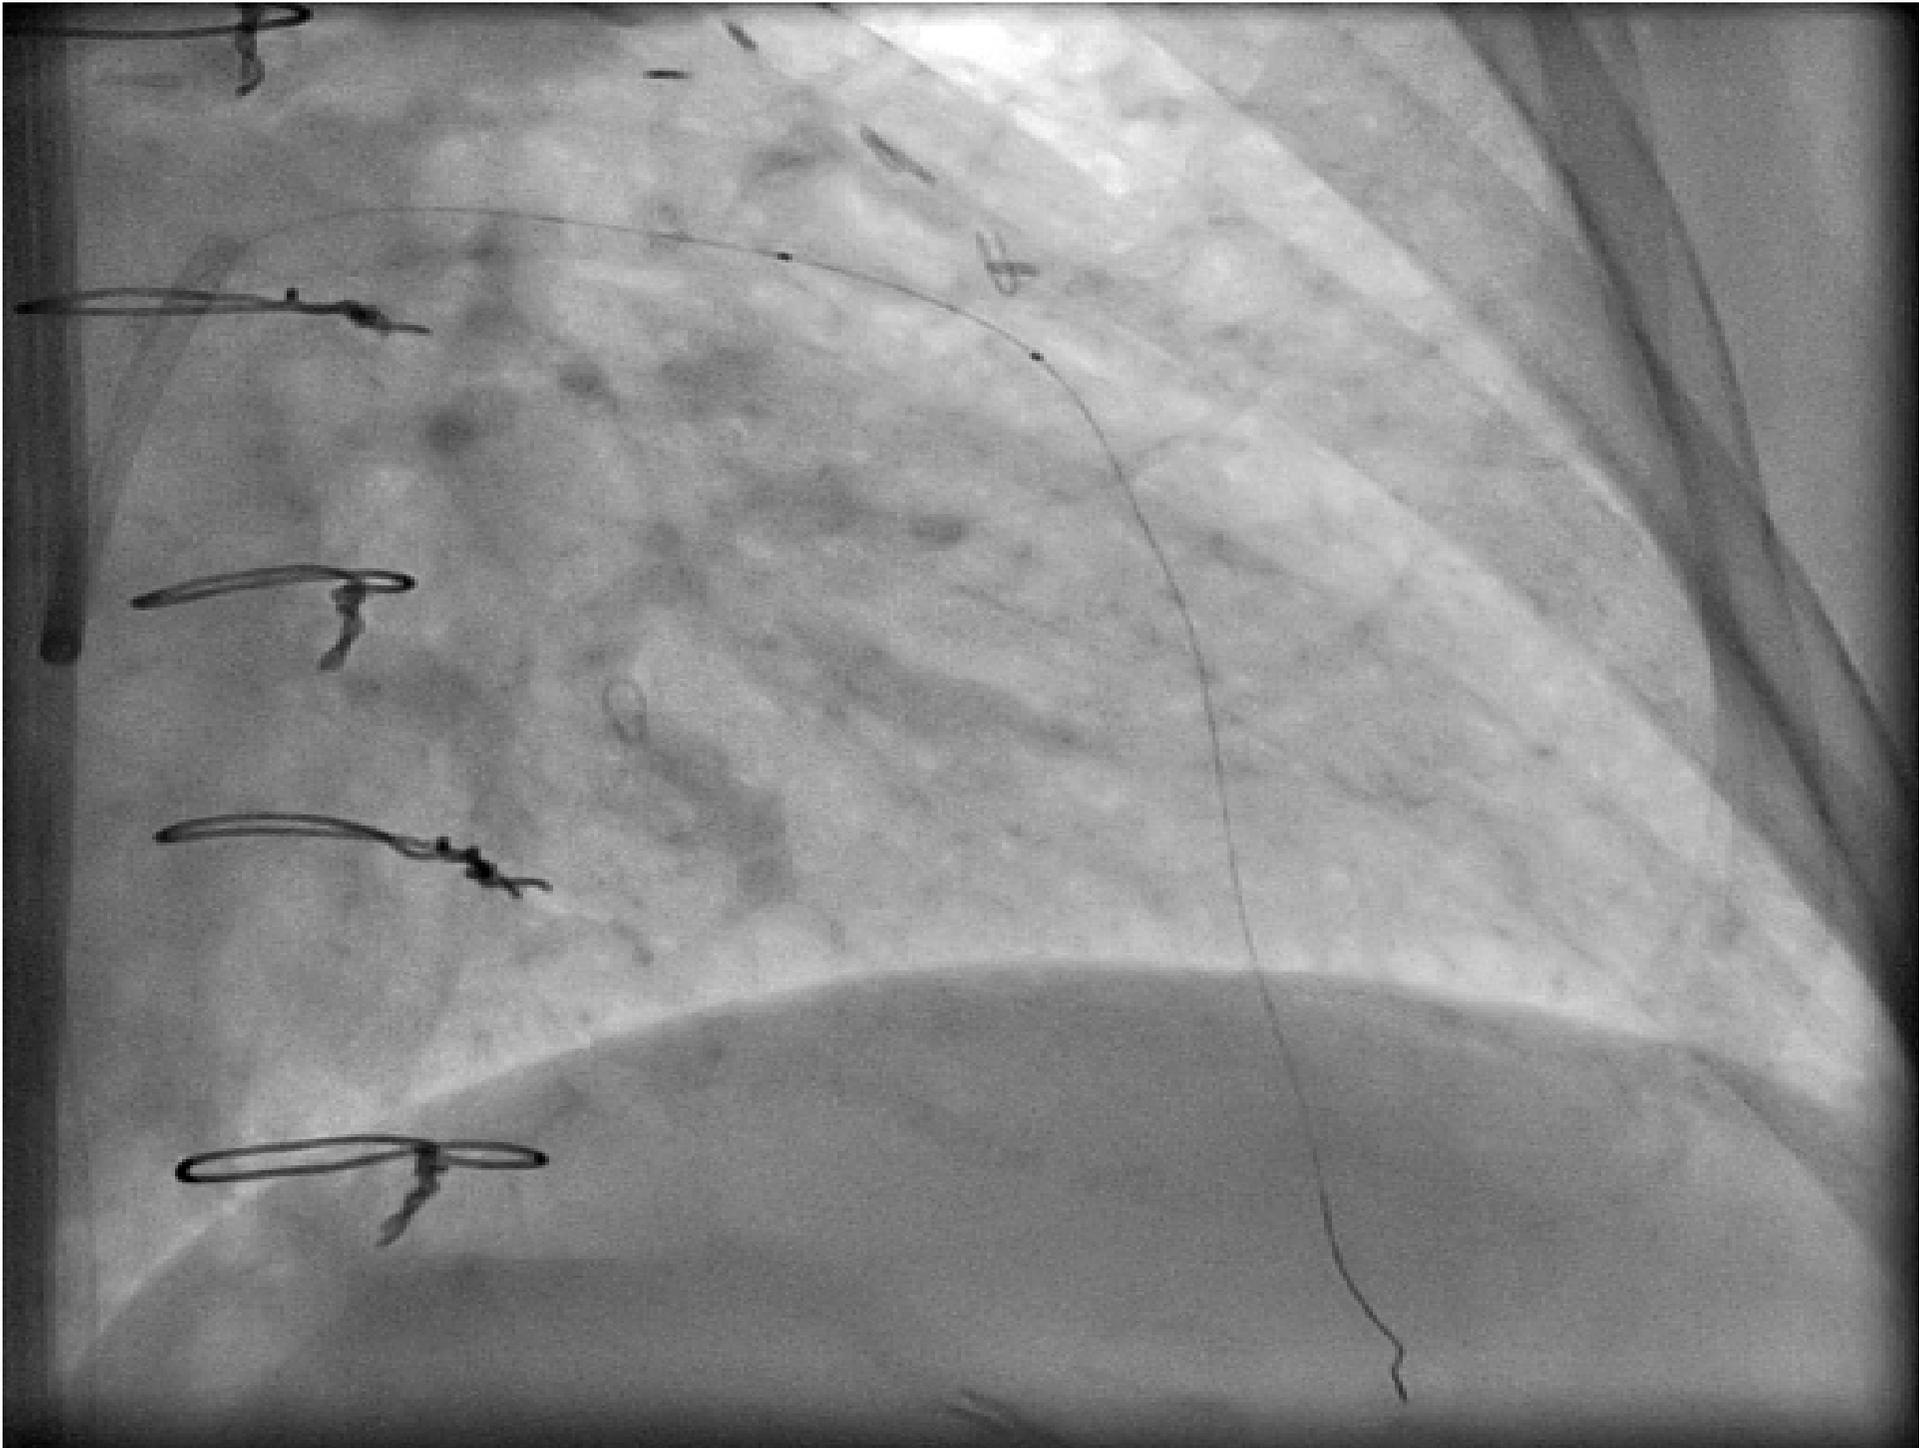


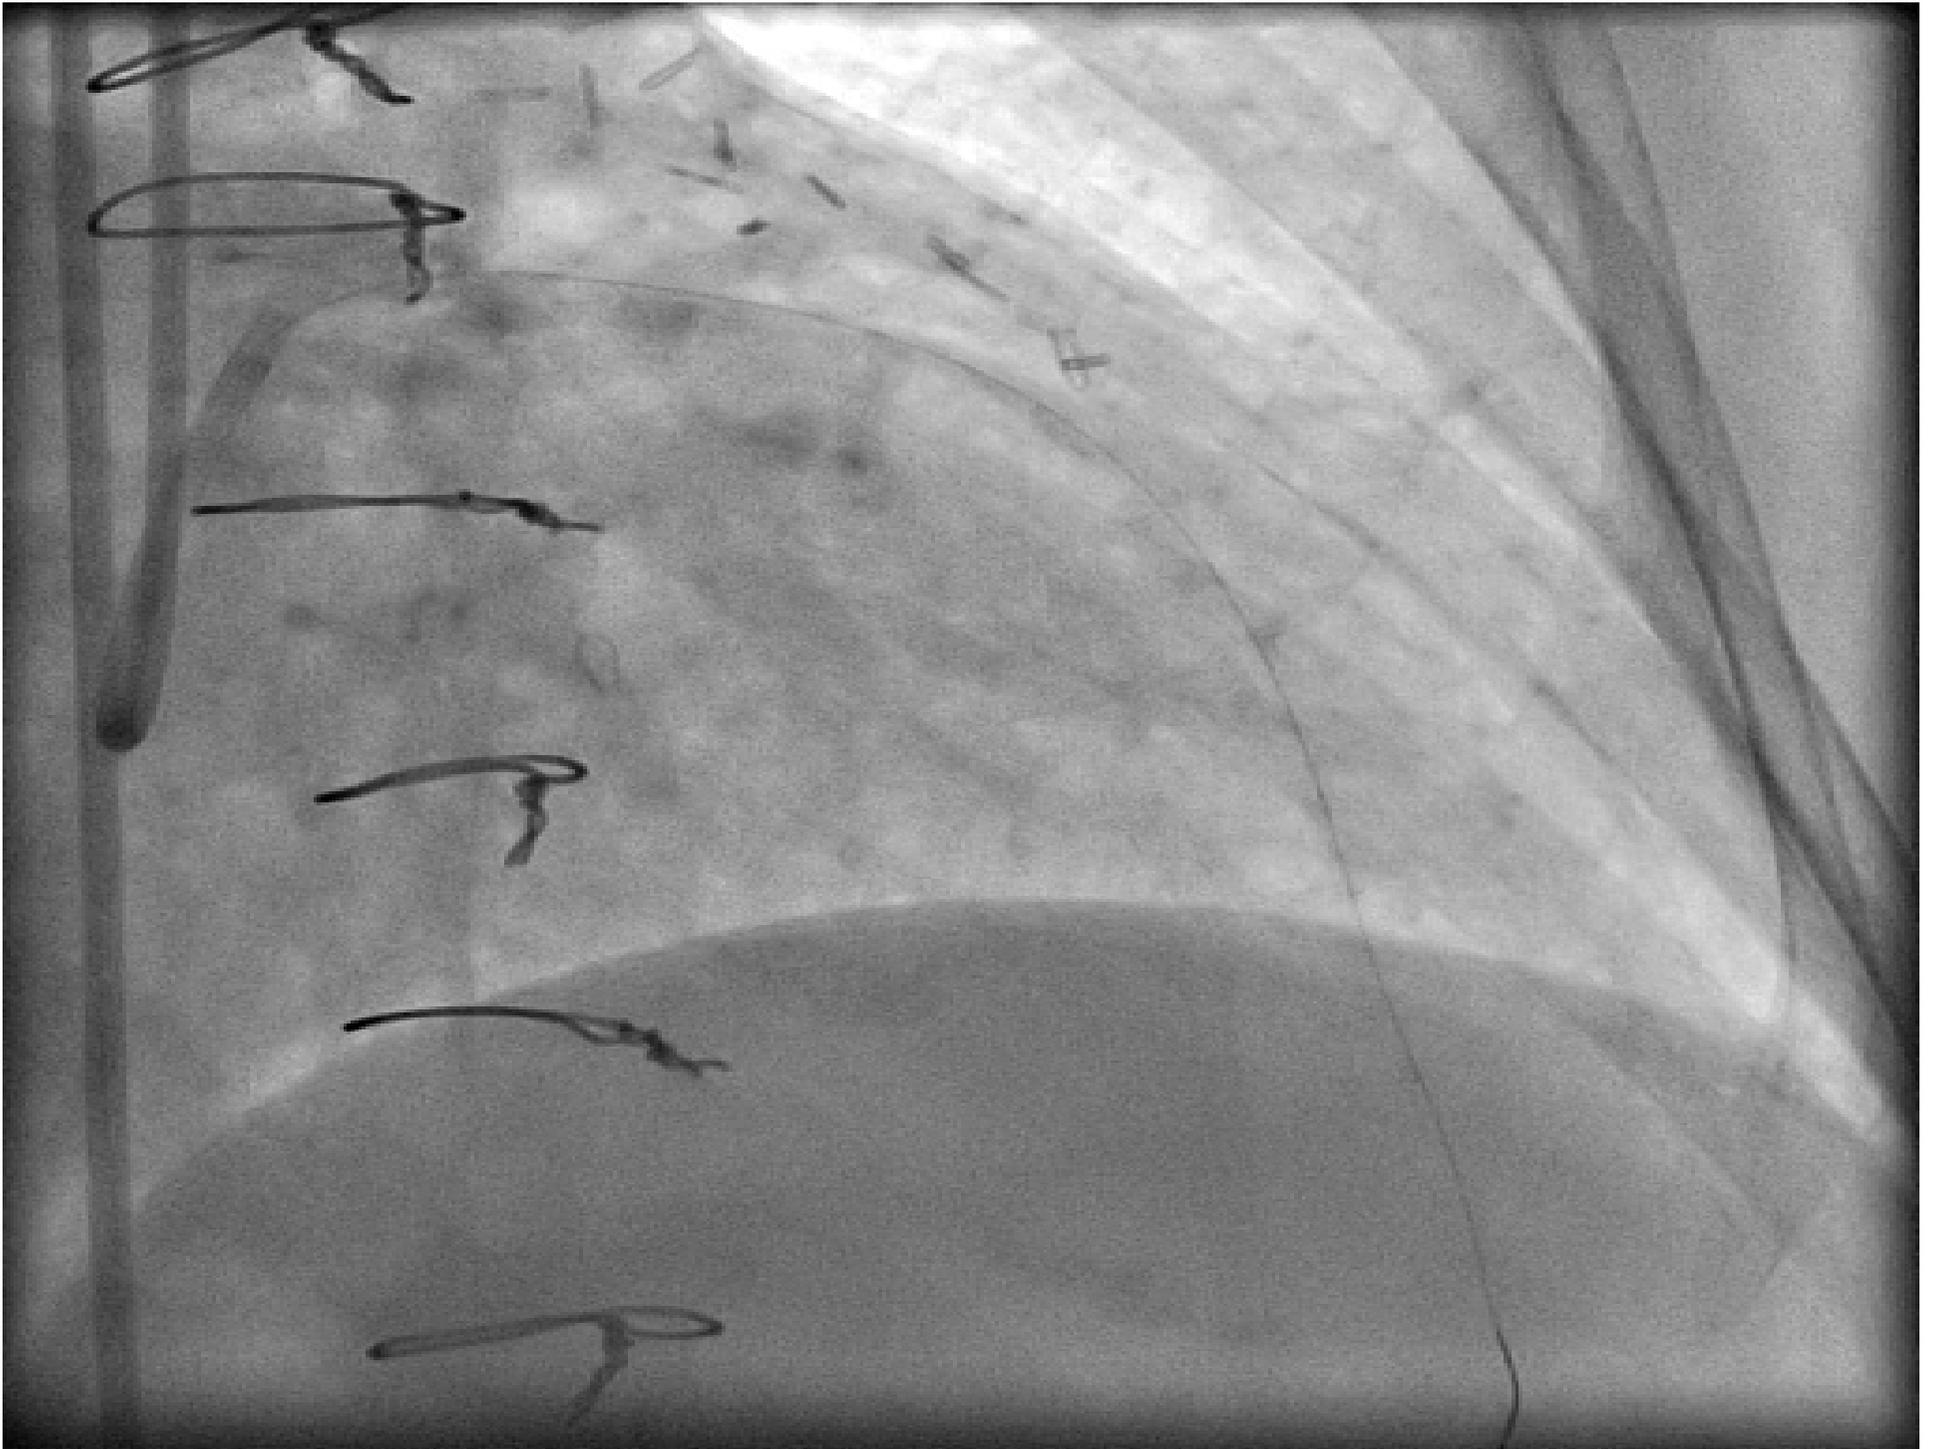



- 2,75/ 28 mm Everolimus kaplı stent
- 2,75/ 15 mm NC balon ile post dilatasyon

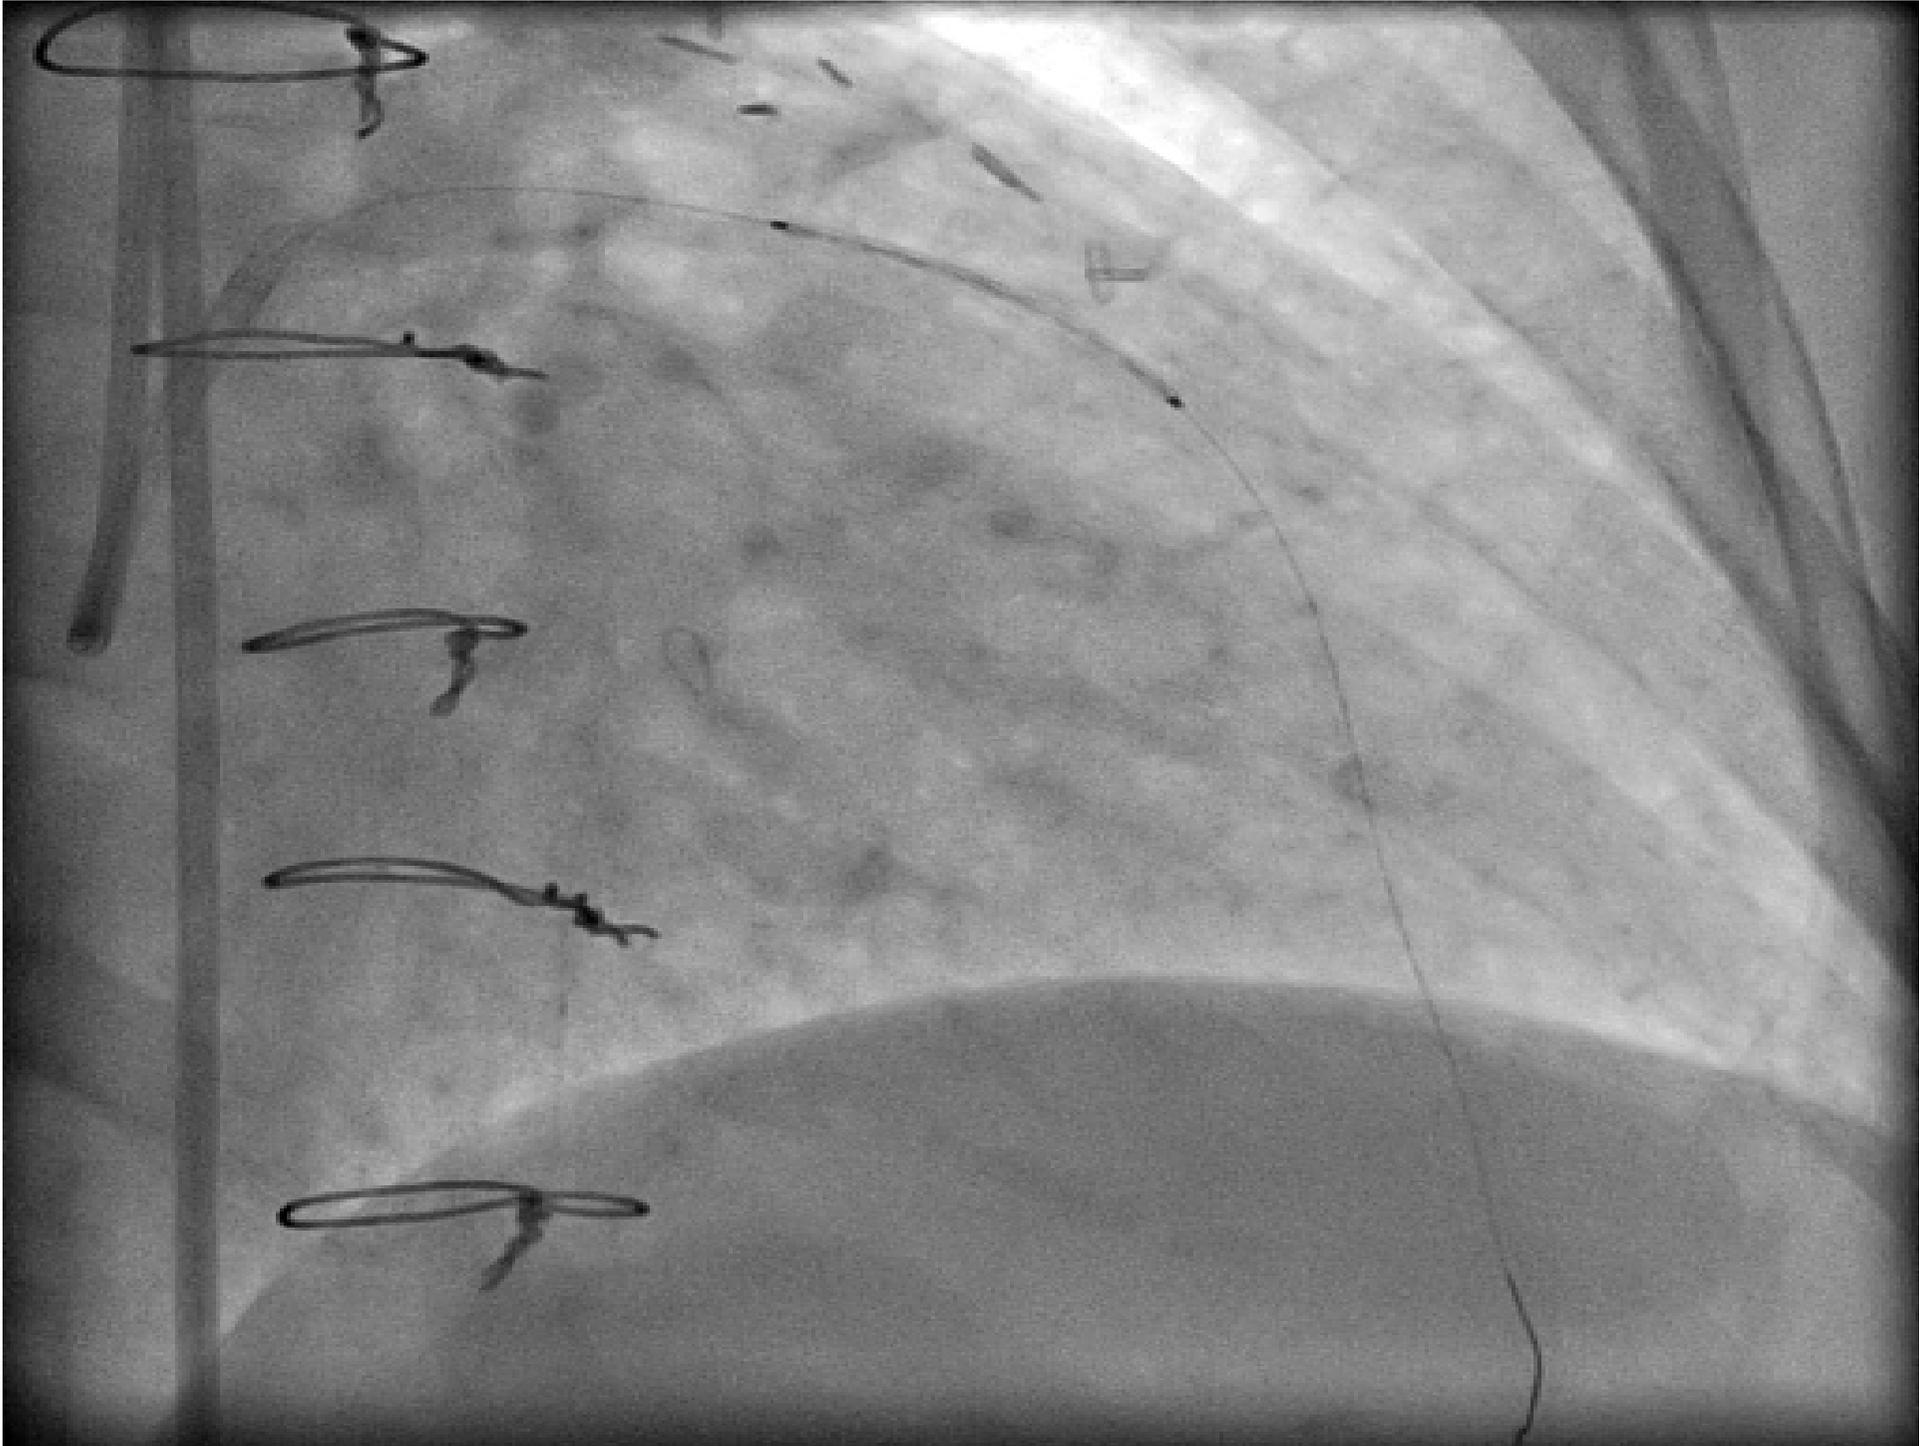


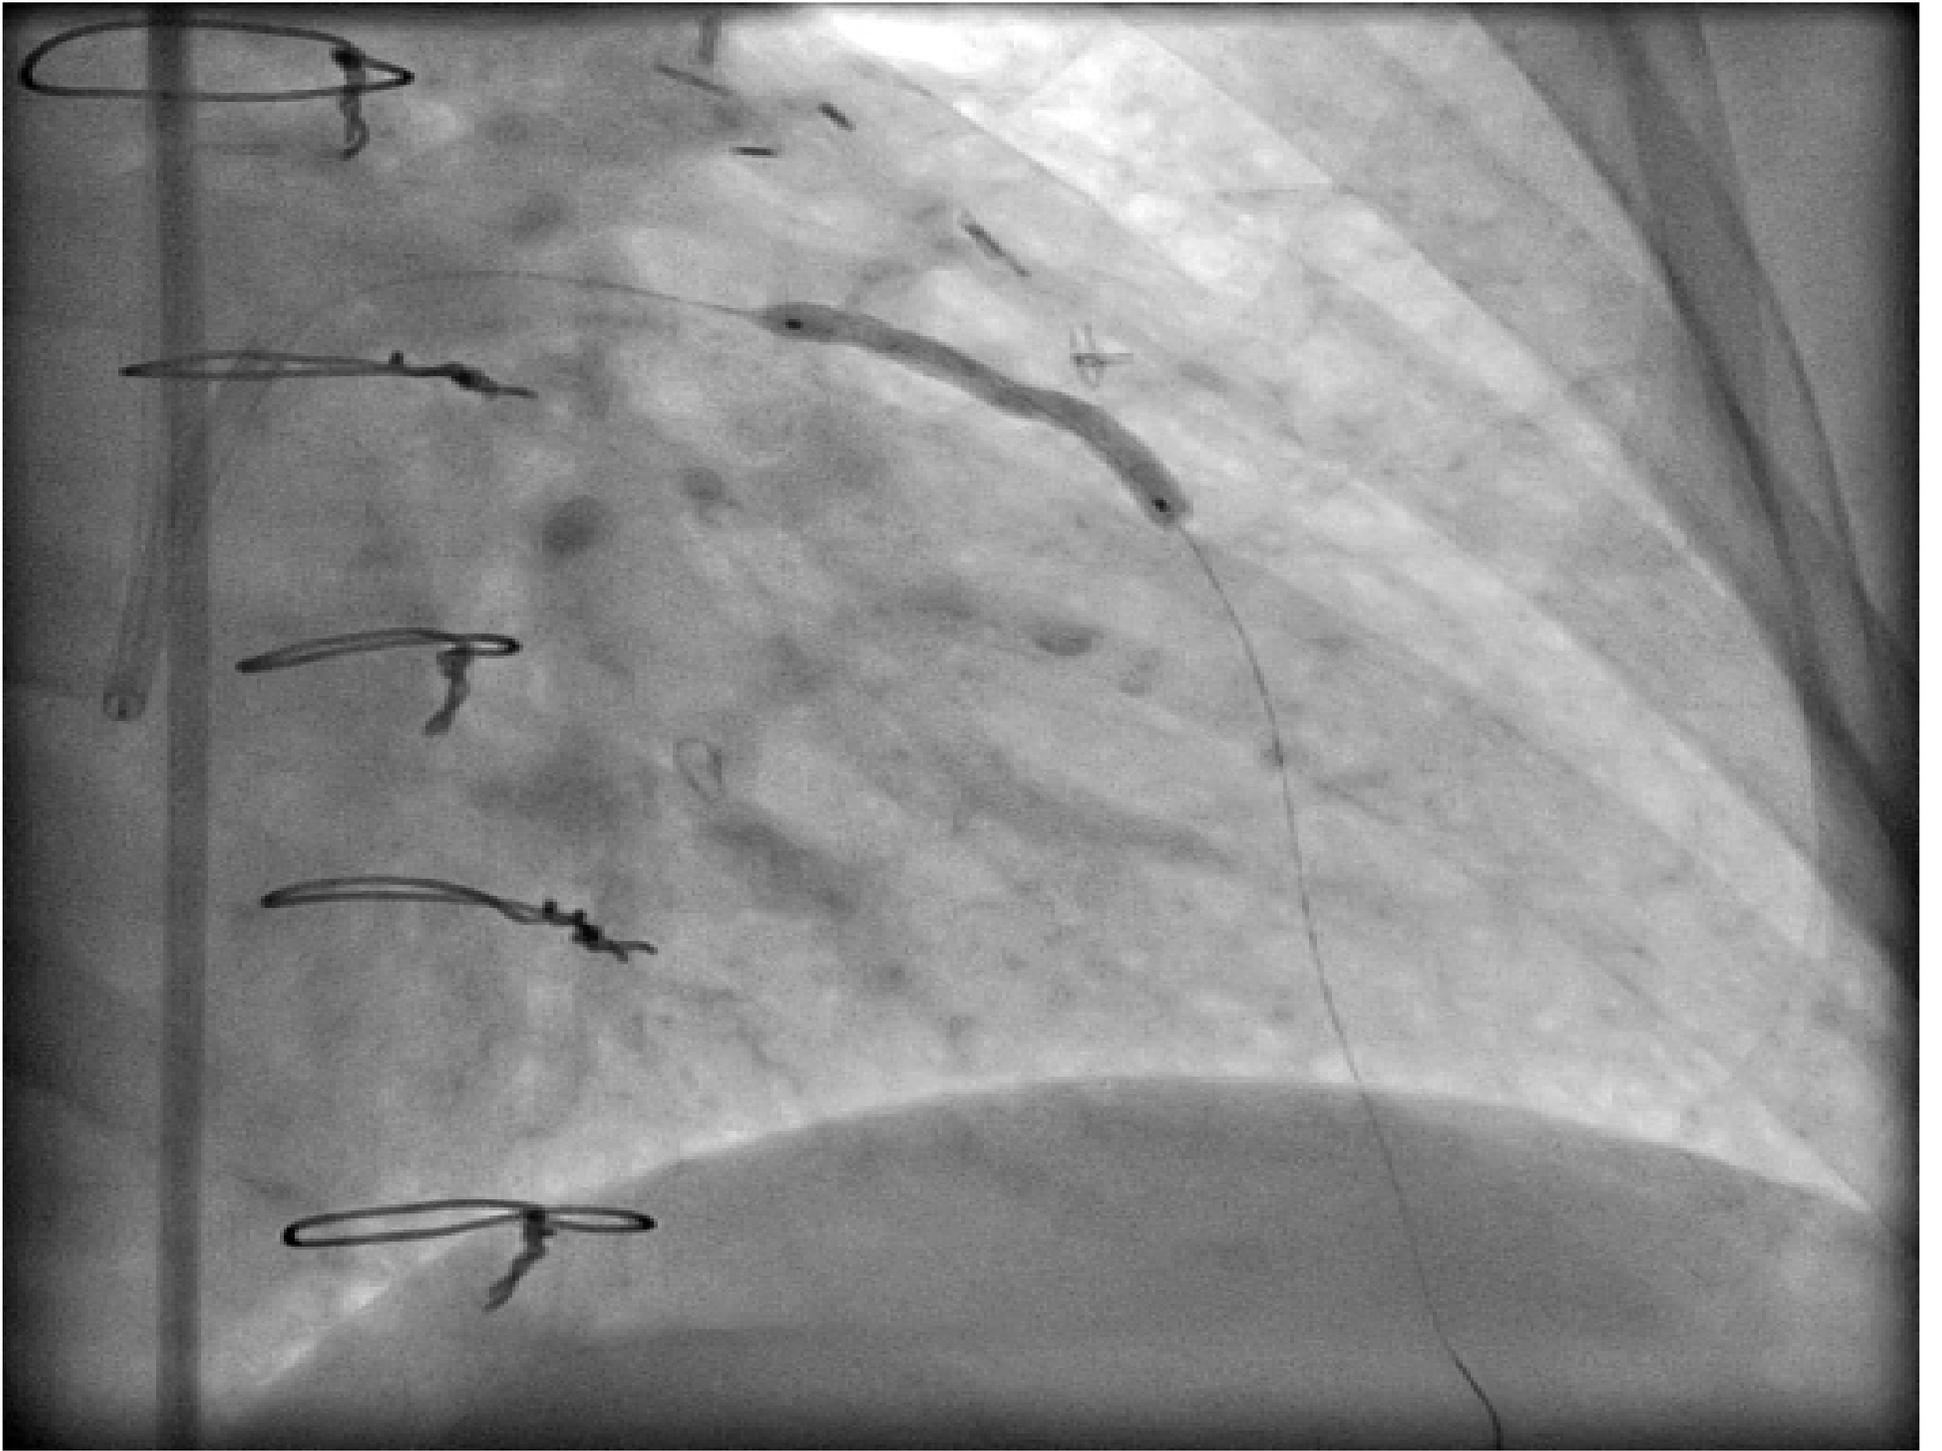


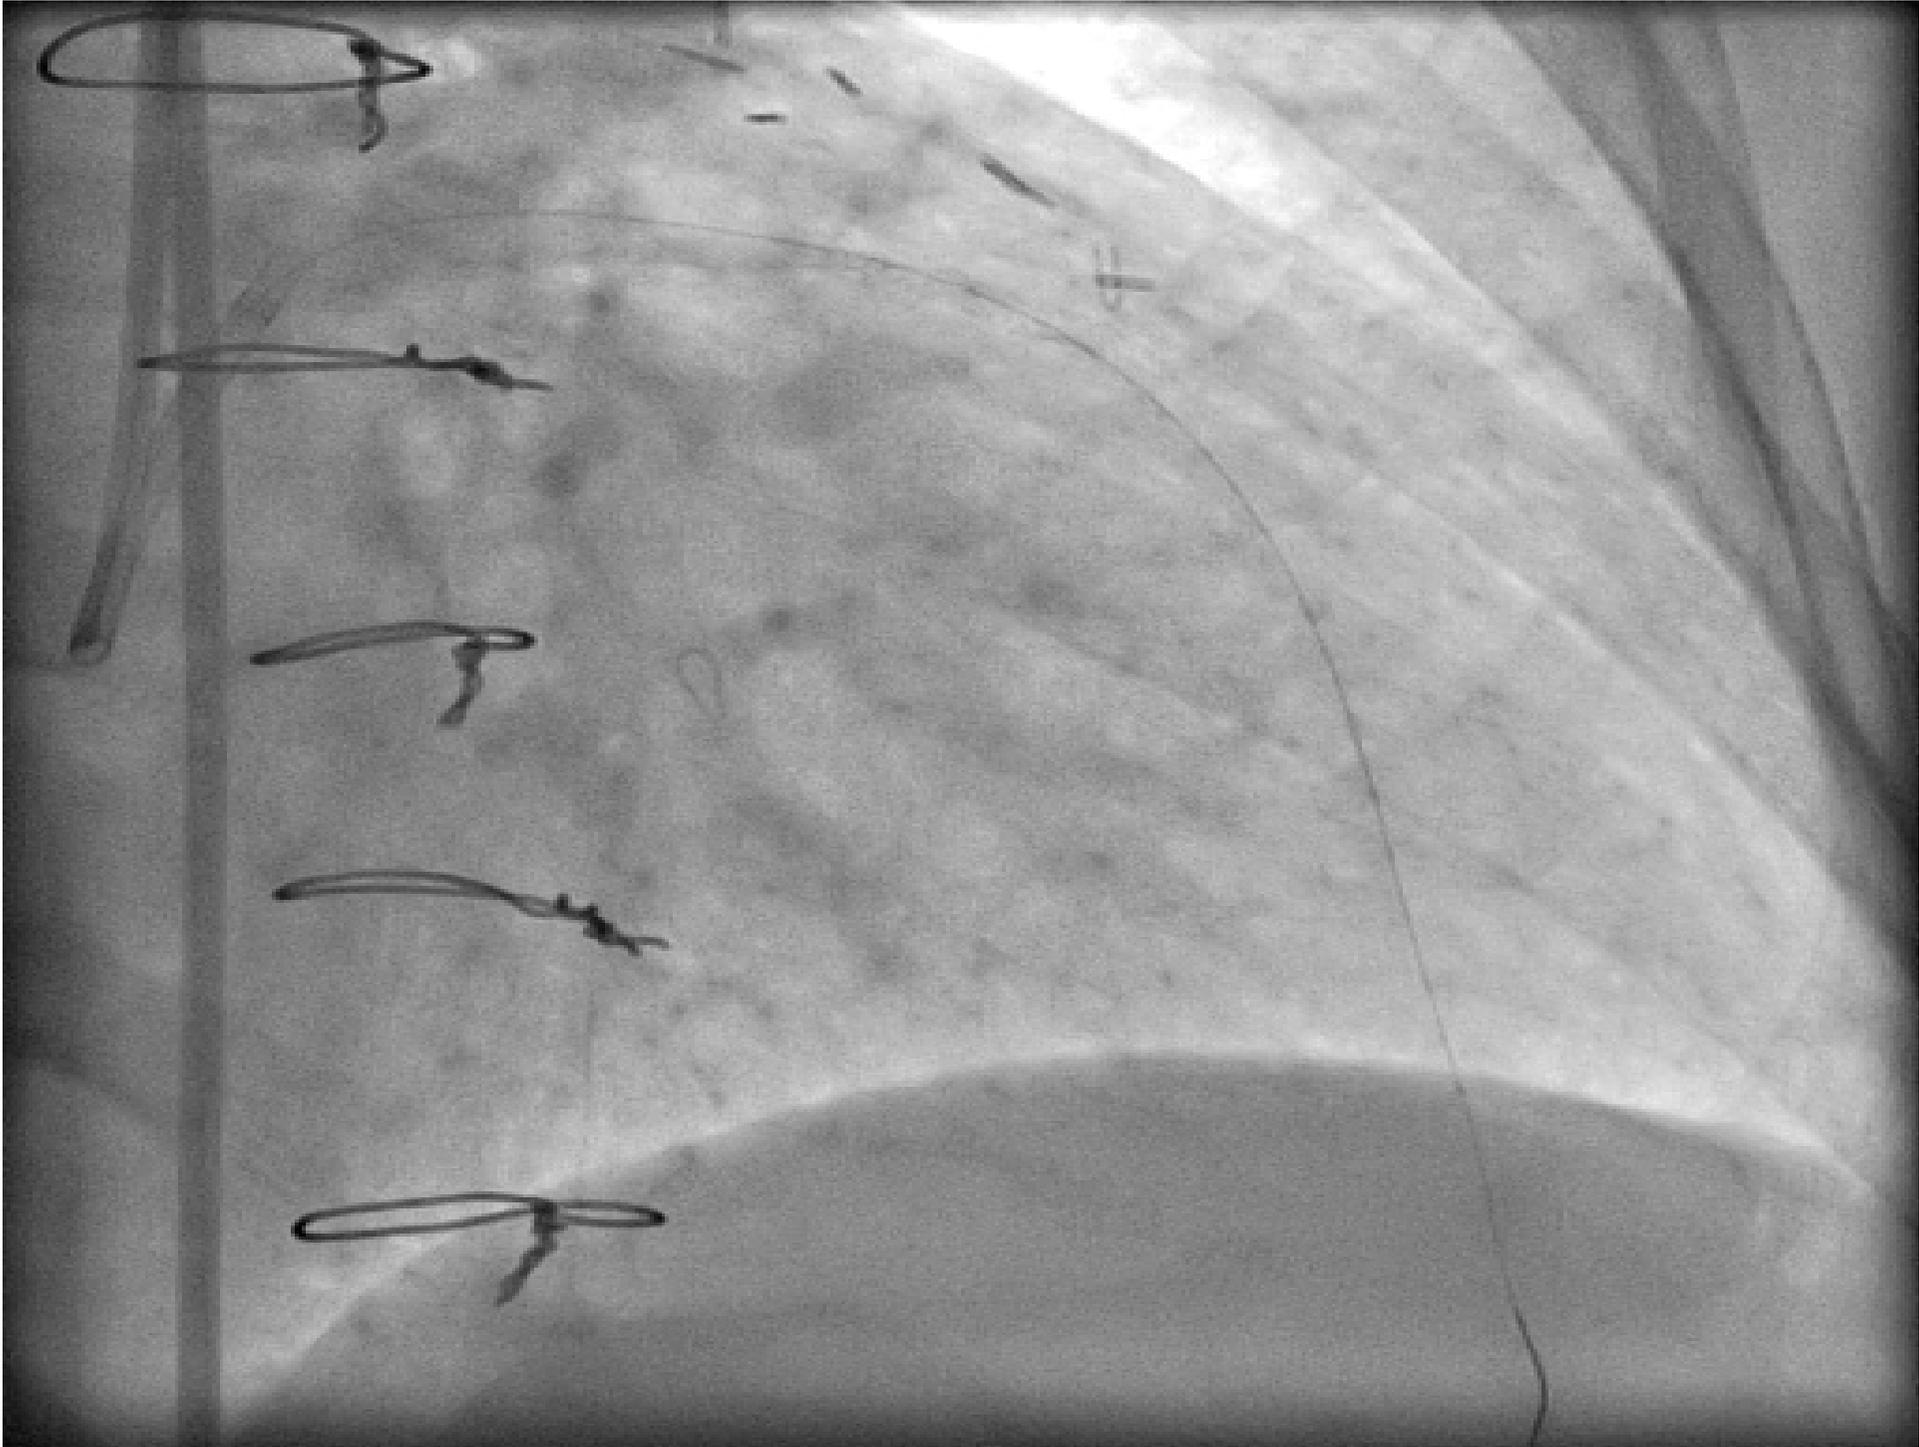


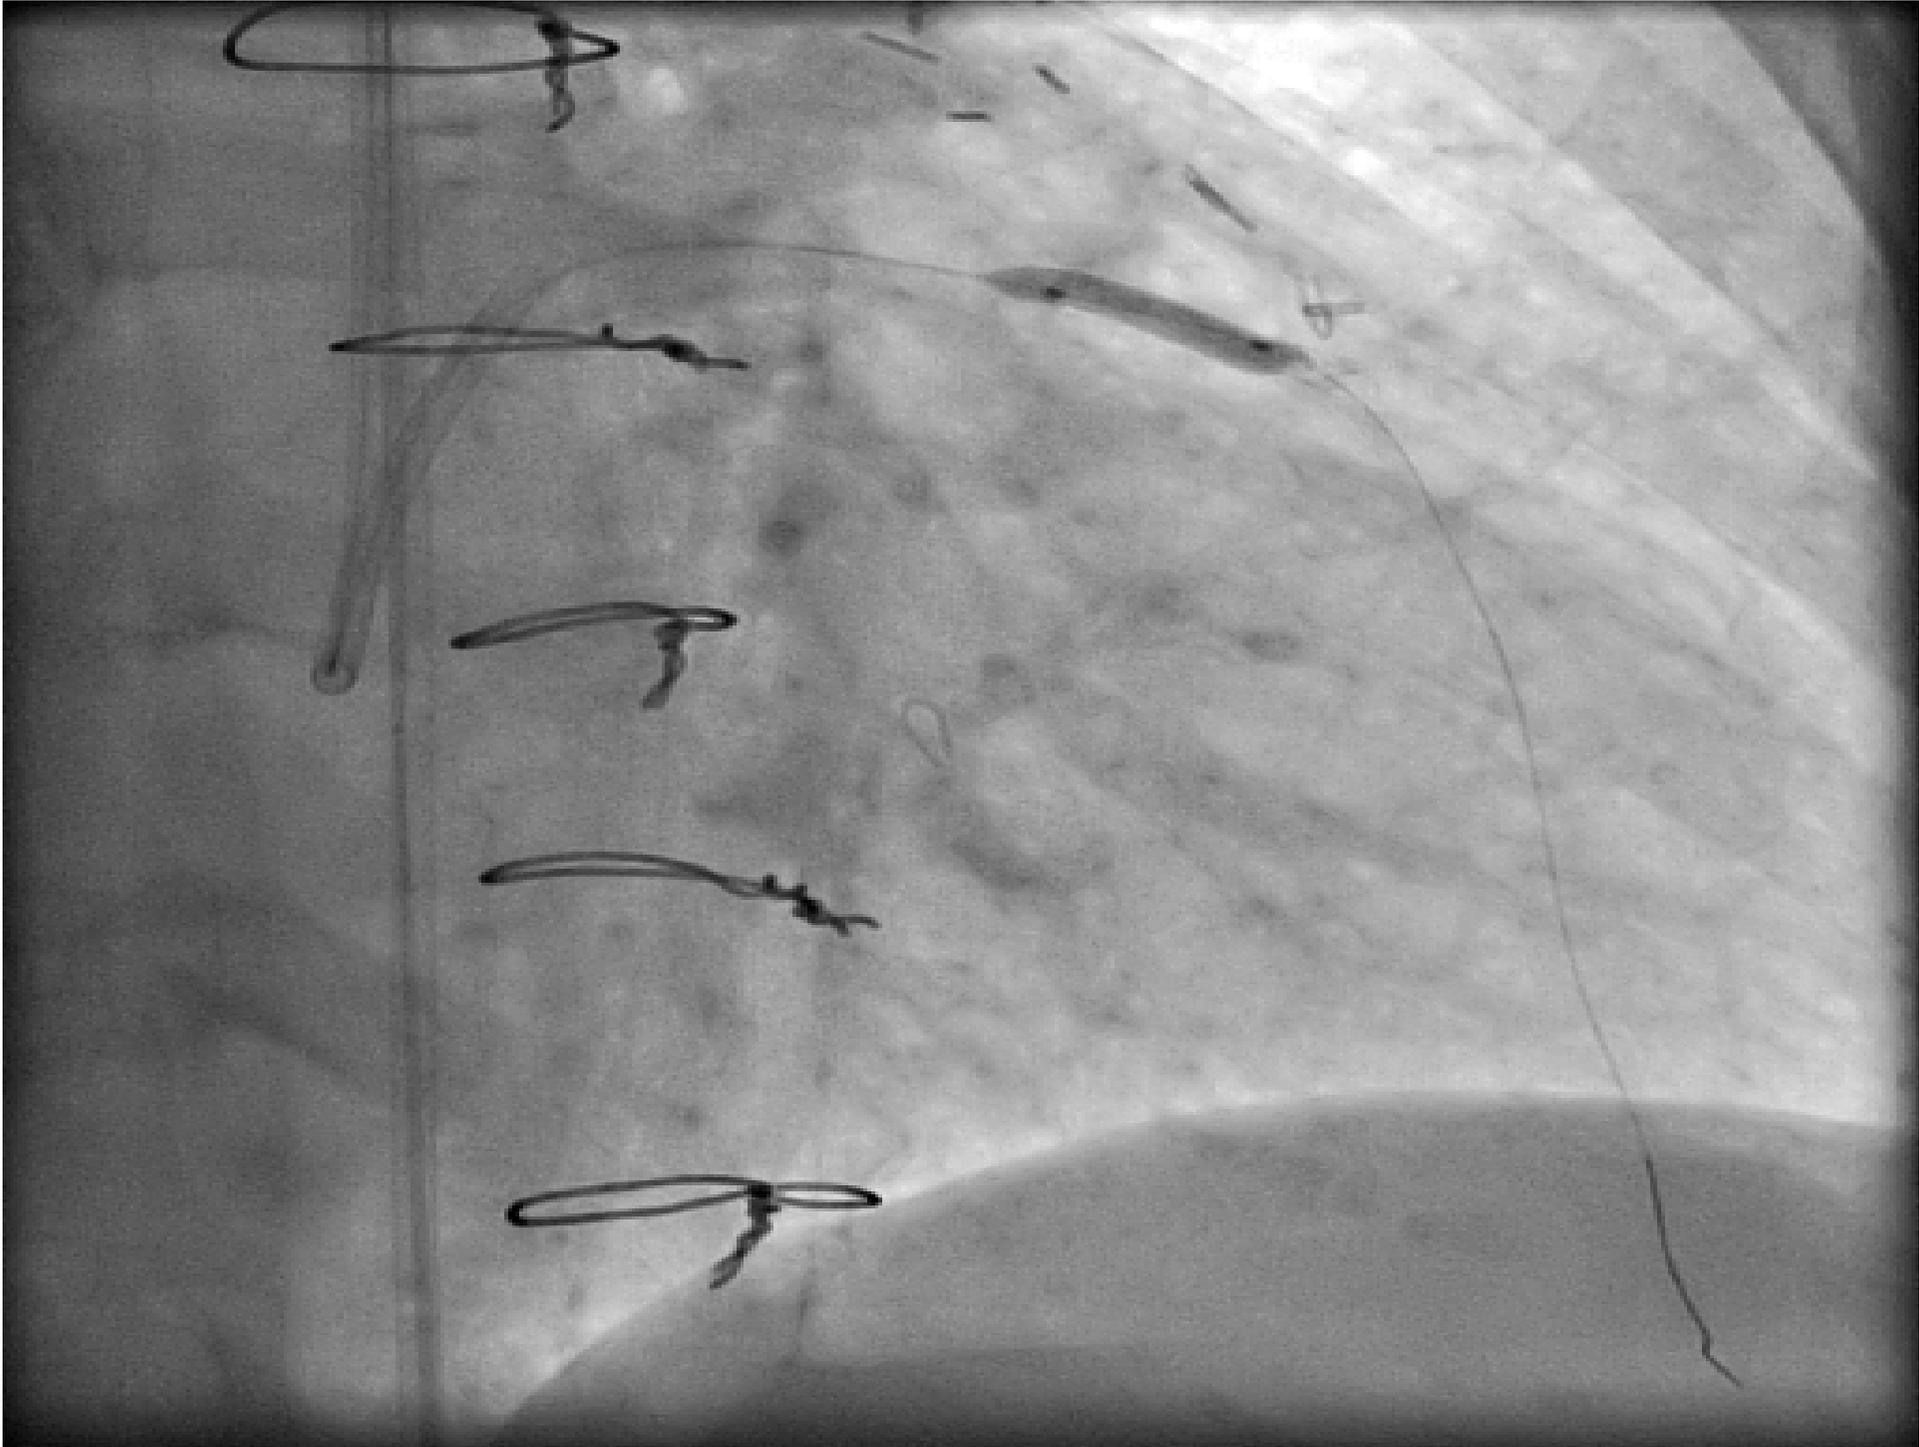

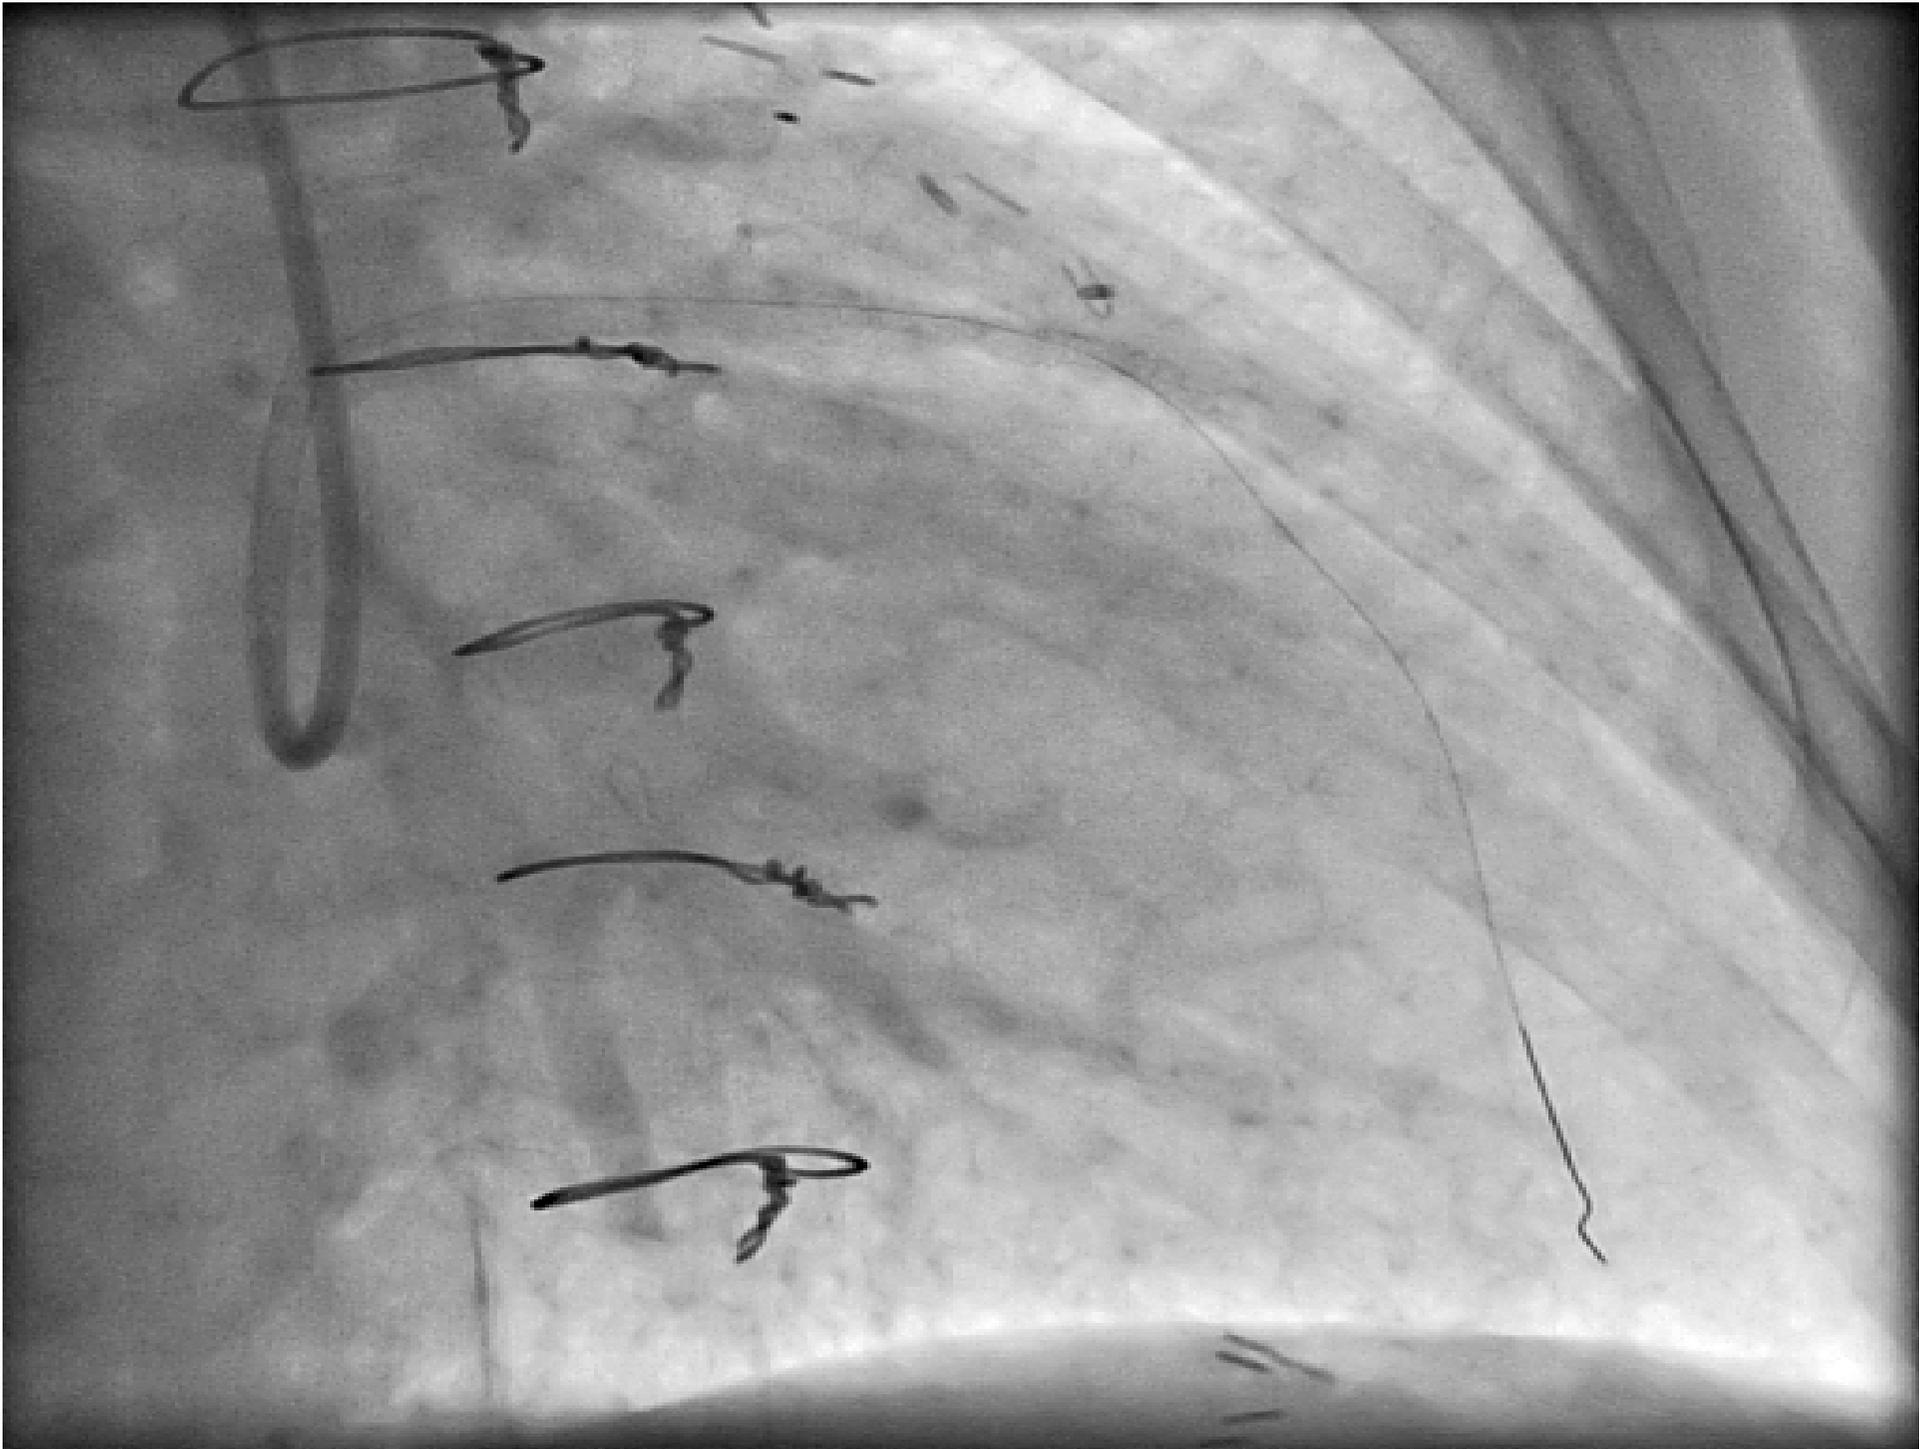

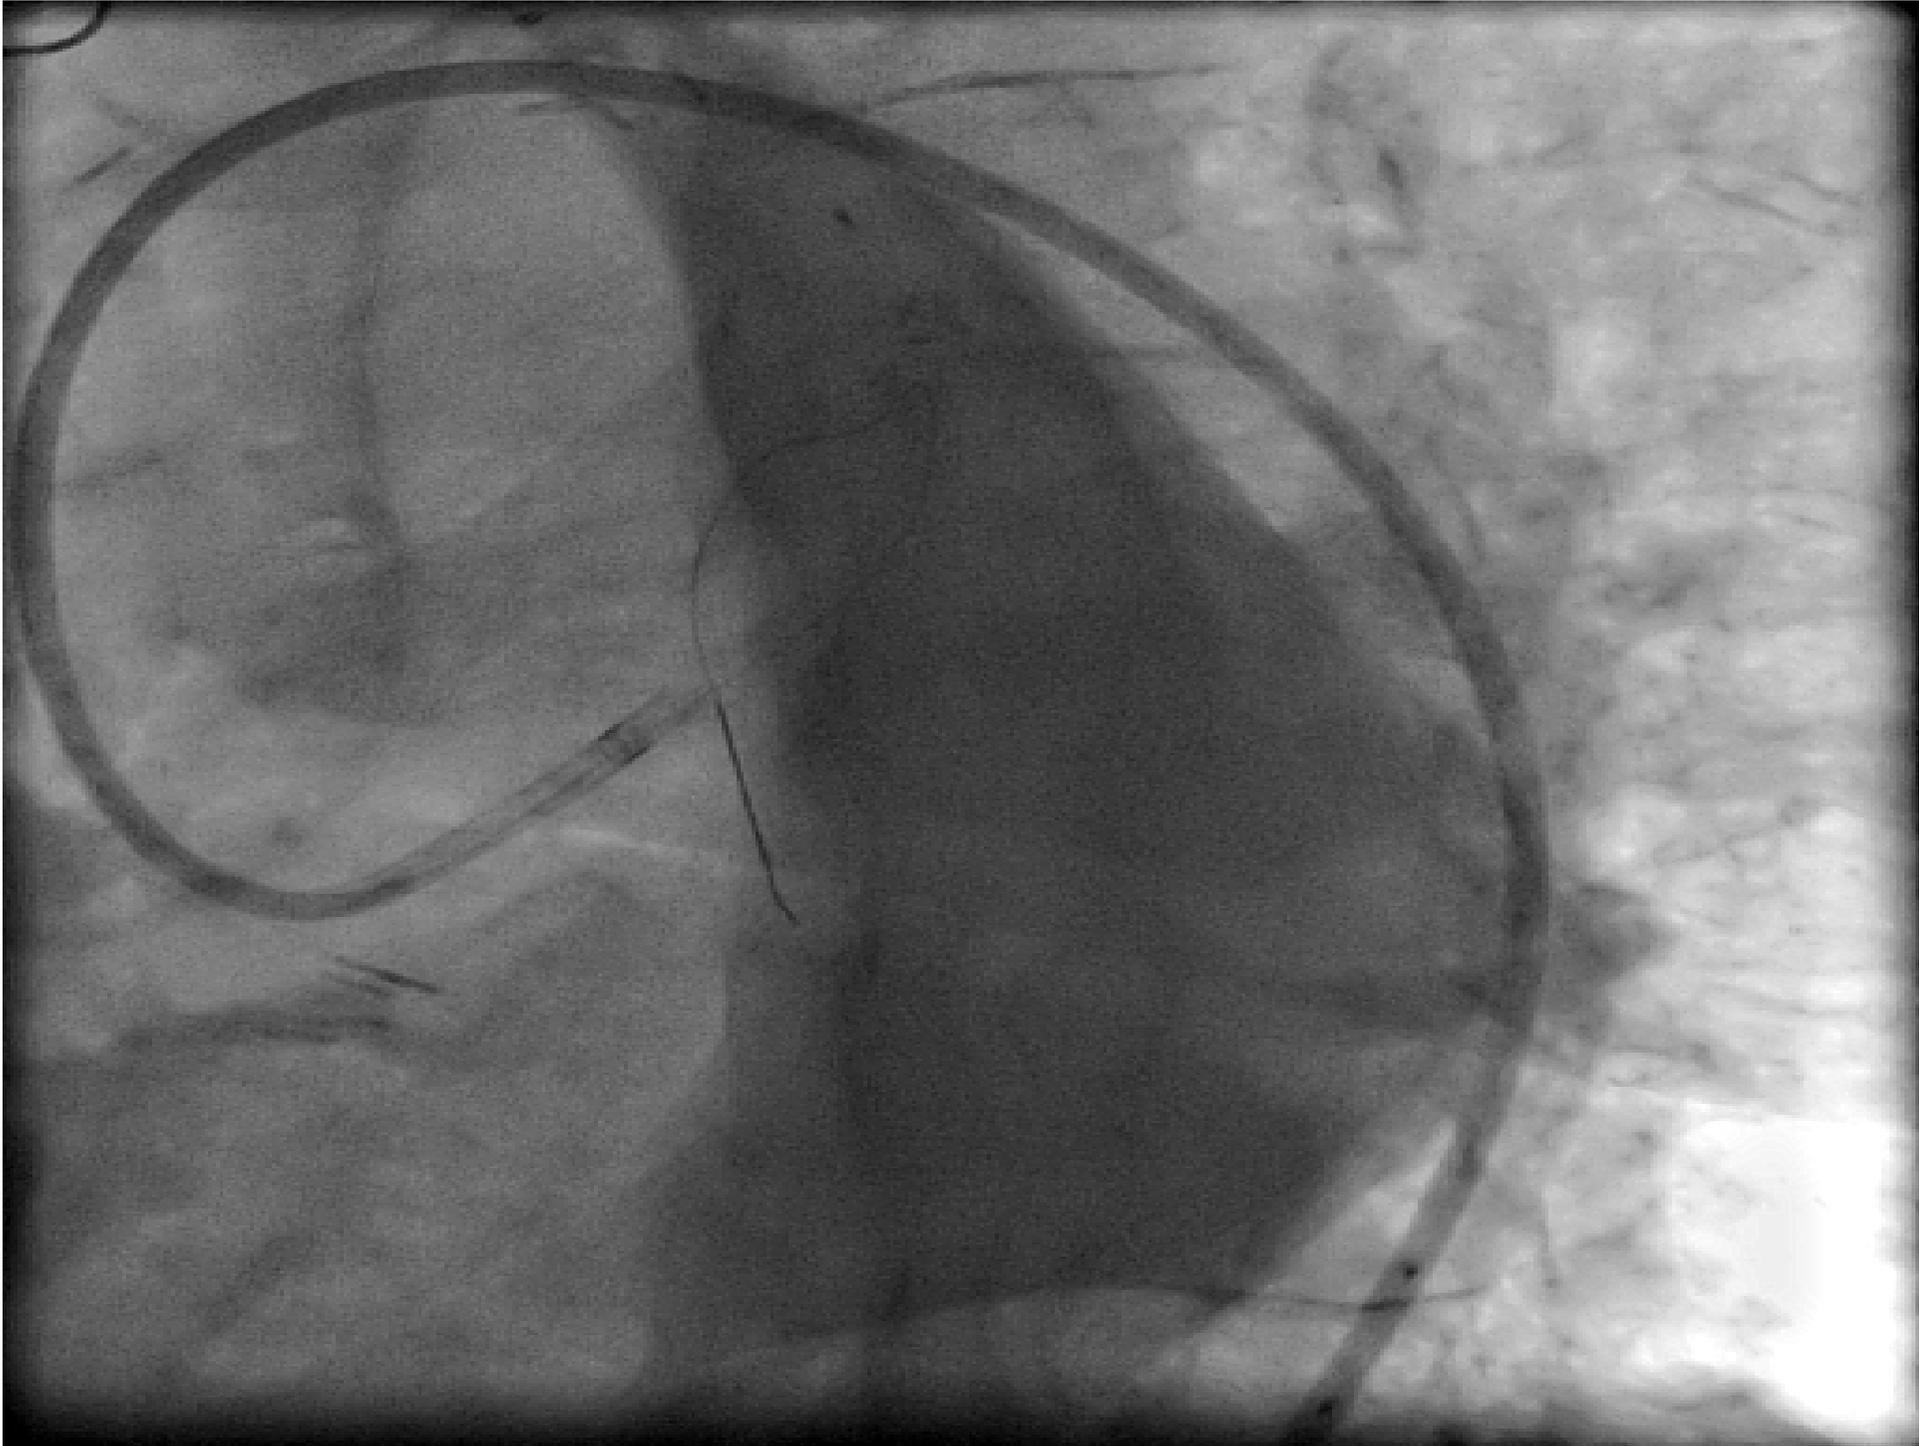

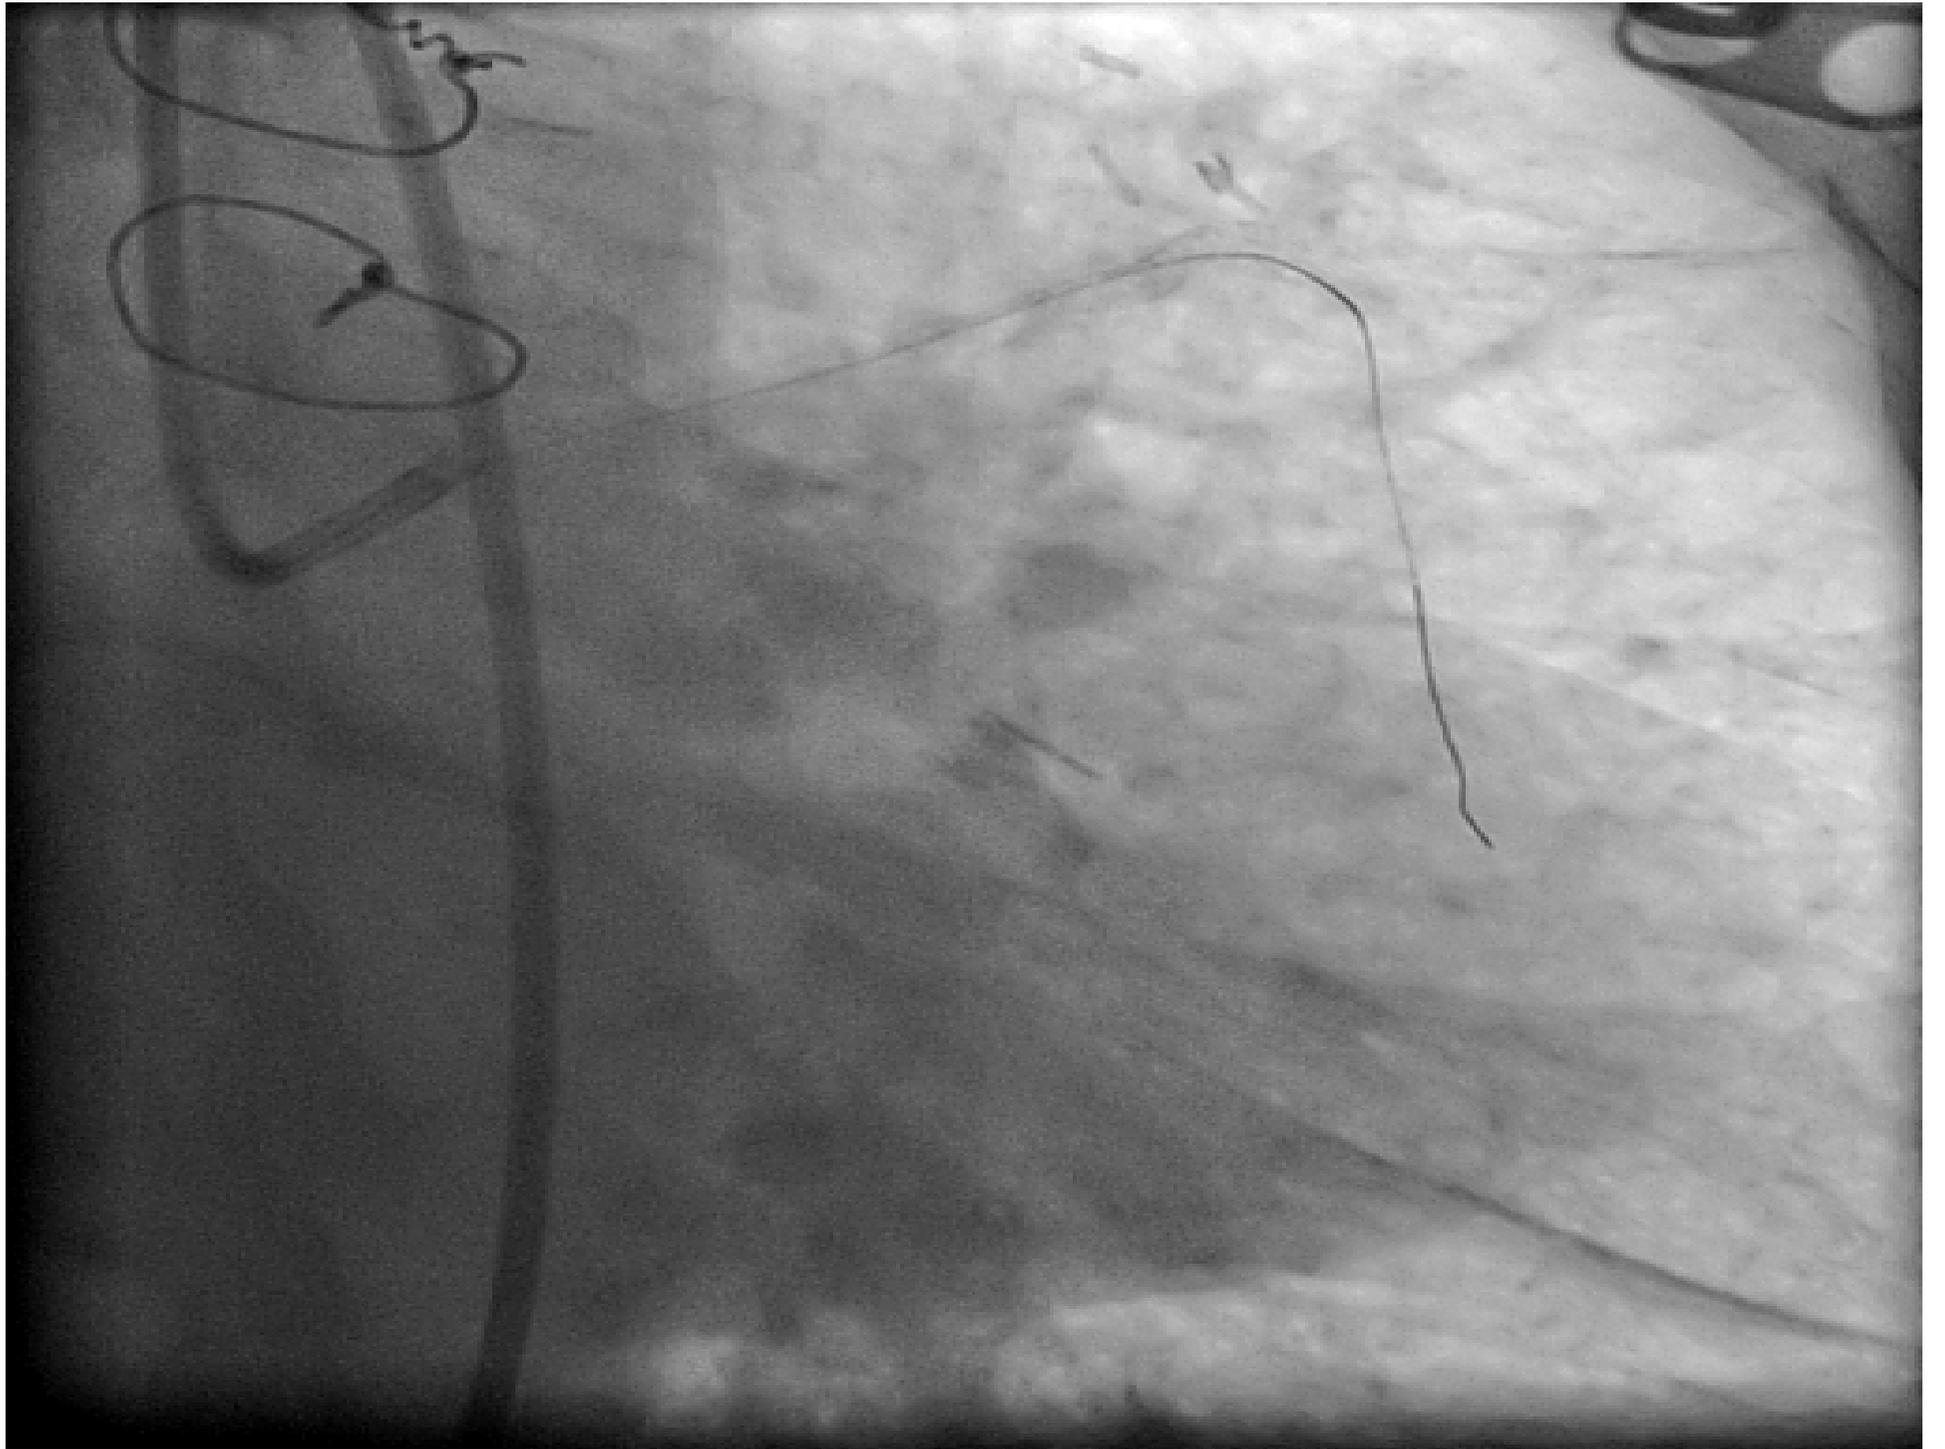

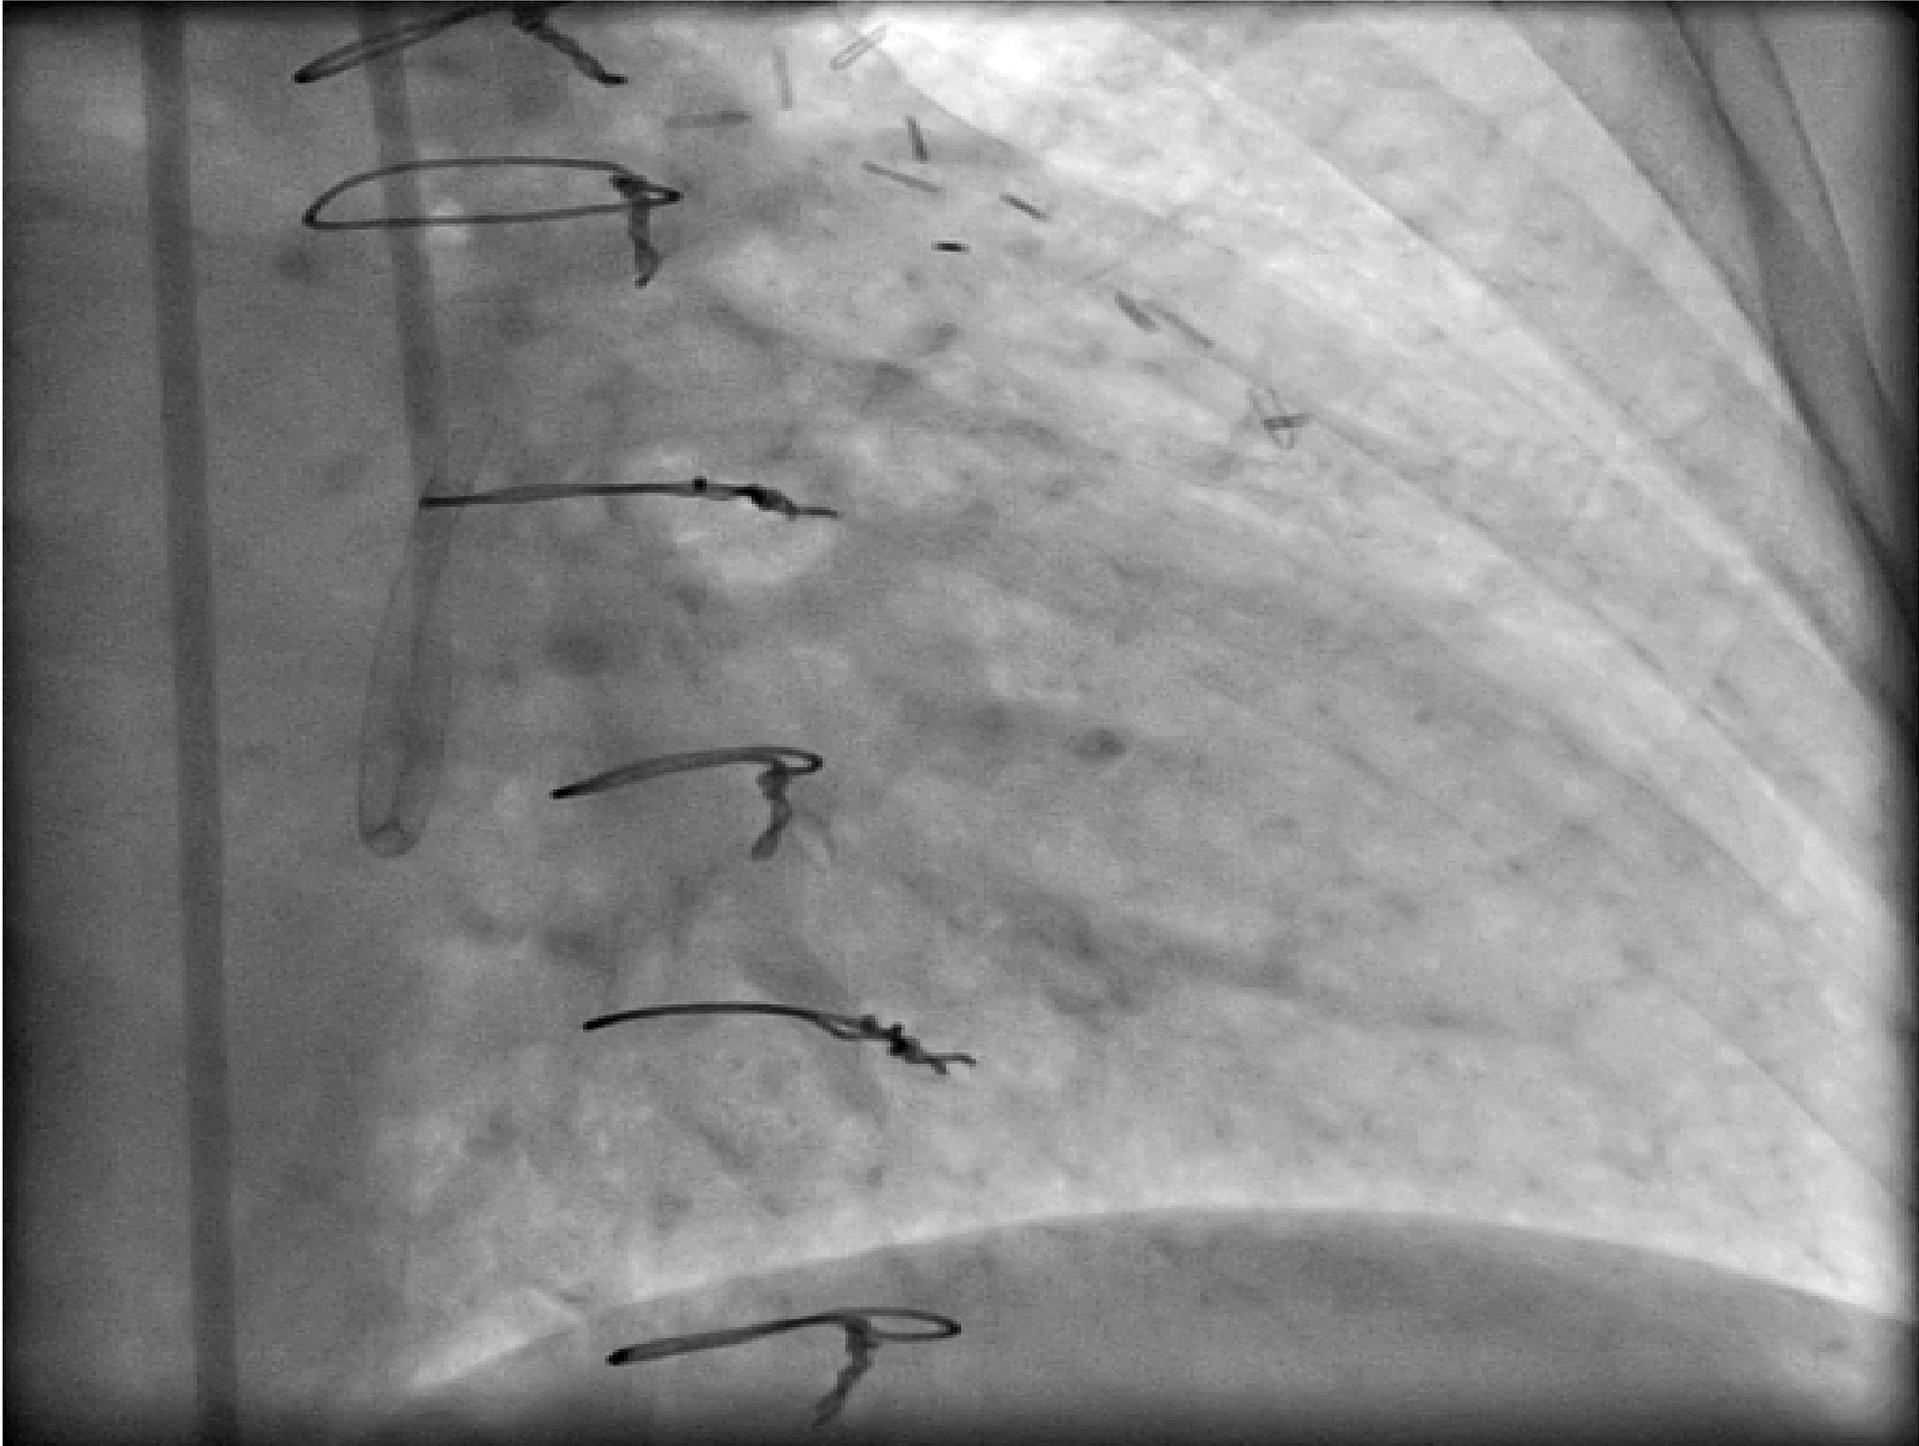



TEŞEKKÜRLER...